



Données Patient		TRAORE KEMO
Date de naissance	01/01/1987	
Age	37	
Société	CR18	
ID	24060311421322724	

Date du test: 03/06/2024 11:49:14
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

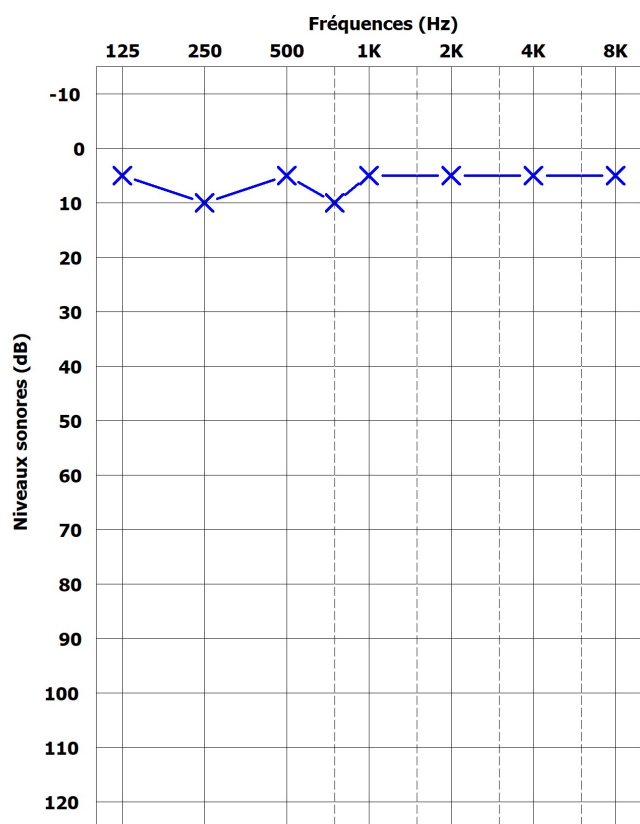

Oreille Gauche

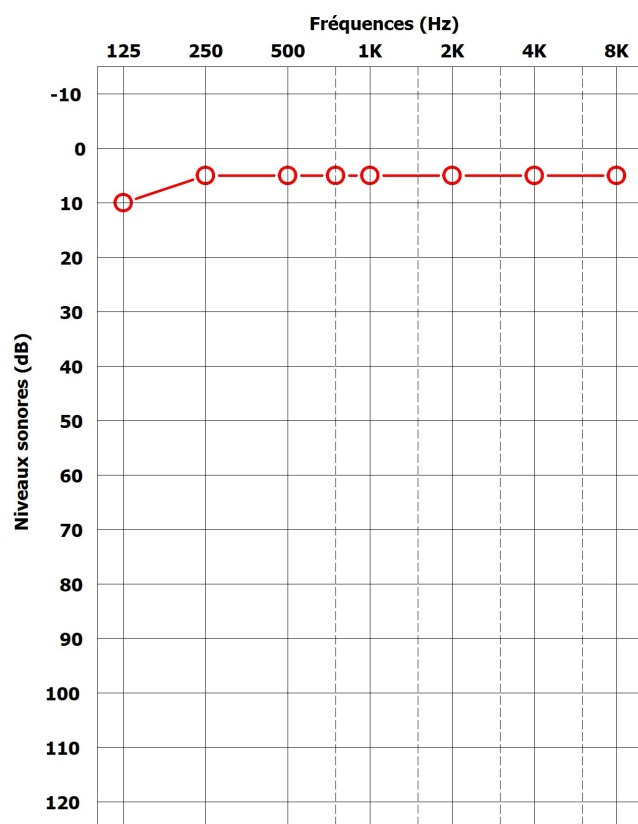

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	10	5	10	5		5		5		5
CA Droit	10	5	5	5	5		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	5,0 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes