

MEDVIE

Date du test: 20/05/2024 17:11:18

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

CONDE SEKOU

Date de naissance 01/01/1984

Age 40

Société CR18


ID 24052017103452665

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

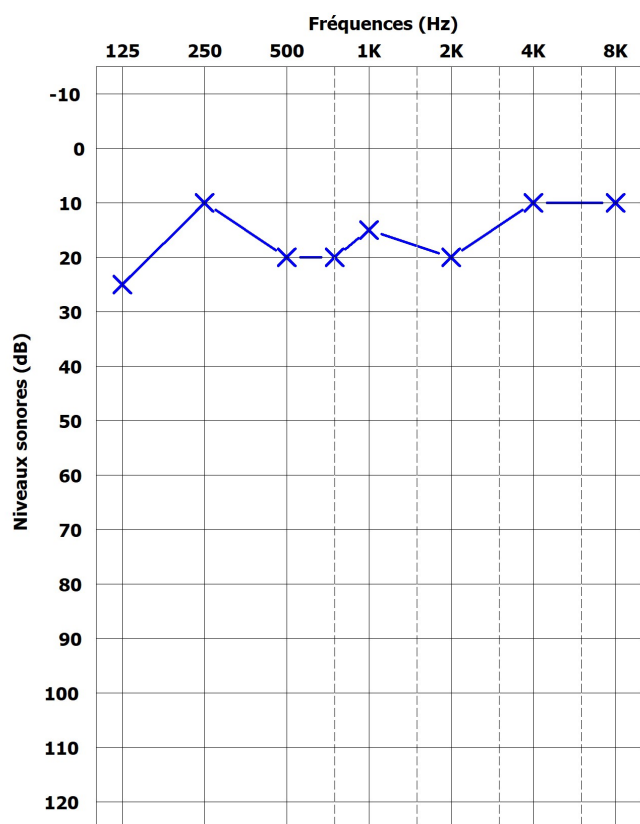

Oreille Gauche

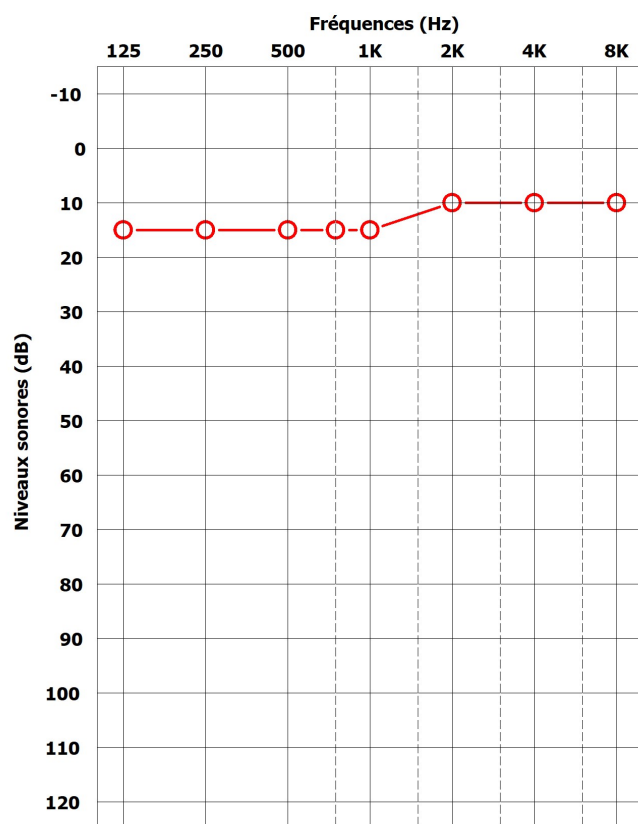

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	20	20	15		20		10		10
CA Droit	15	15	15	15	15		10		10		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes