


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 14:16:17
Durée: 3mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/1996
Age	29
Société	CR18
ID	25031414150200964

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

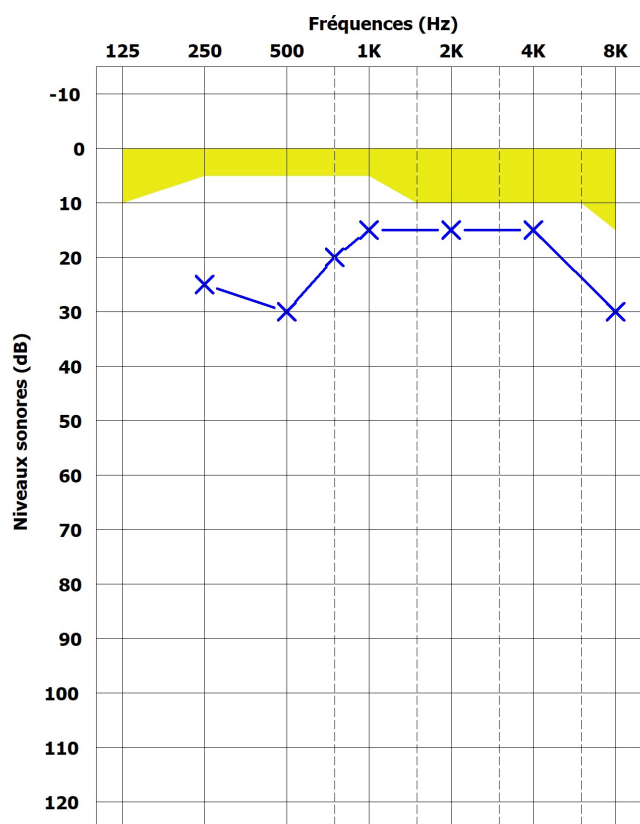

Oreille Gauche

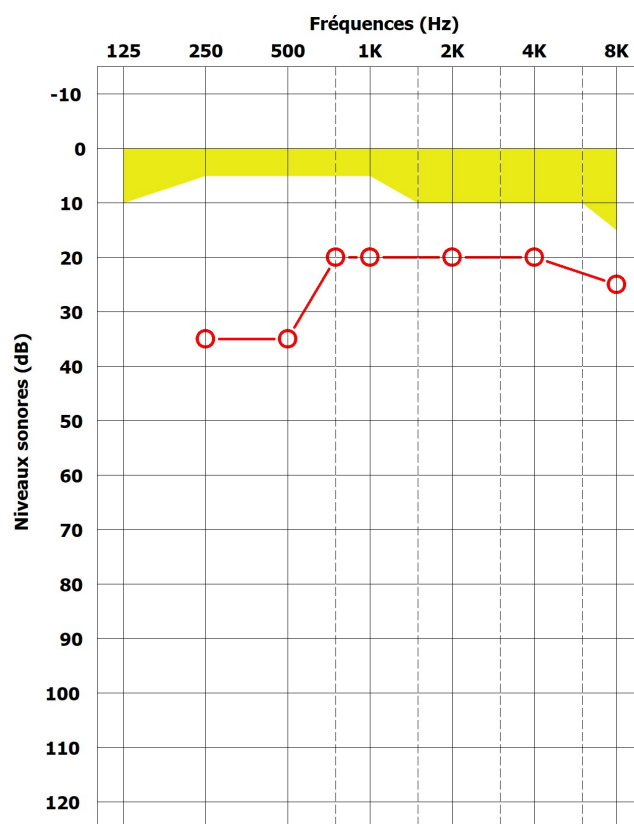

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	20	15		15		15		30
CA Droit		35	35	20	20		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes