


MEDVIE


Date du test: 02/07/2025 11:53:19
Durée: 3mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
JINLONG LUI	
Date de naissance	23/07/1970
Age	54
Société	CR18
ID	25070211500954777

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

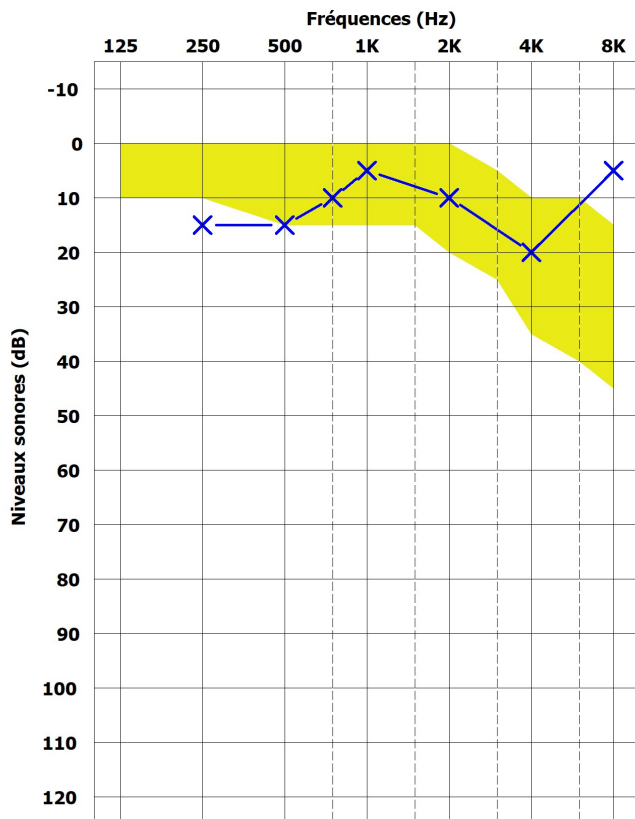

Oreille Gauche

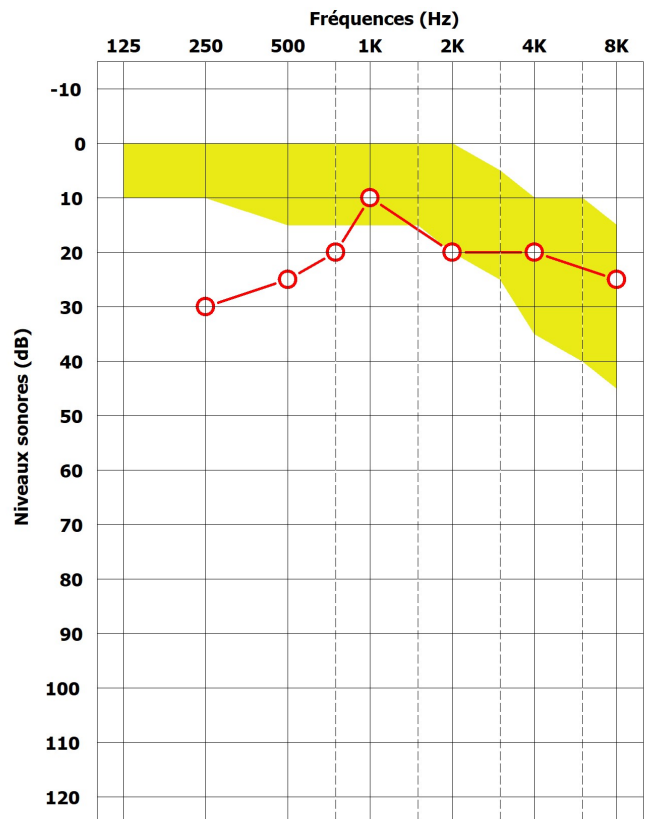

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	5		10		20		5
CA Droit		30	25	20	10		20		20		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes