


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 13:22:01

Durée: 4mn 12s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

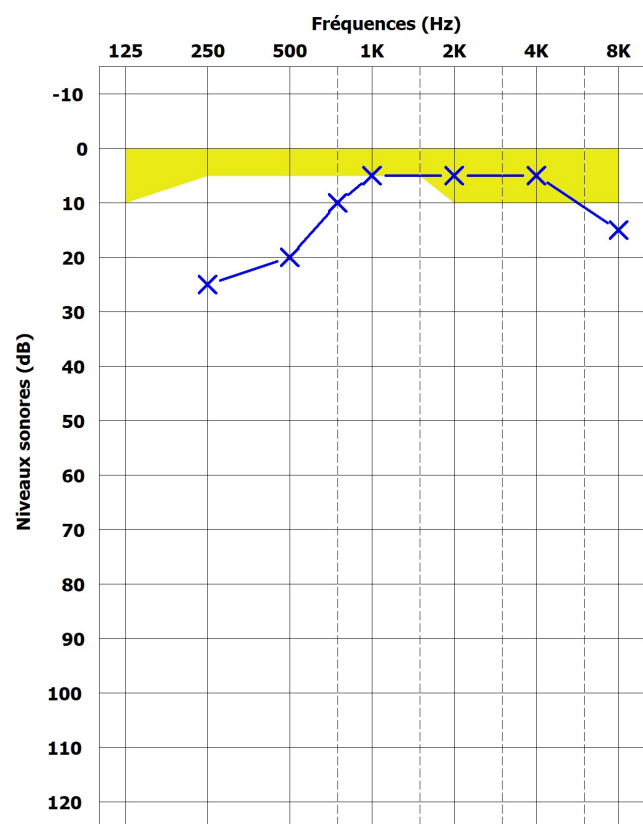

Oreille Gauche

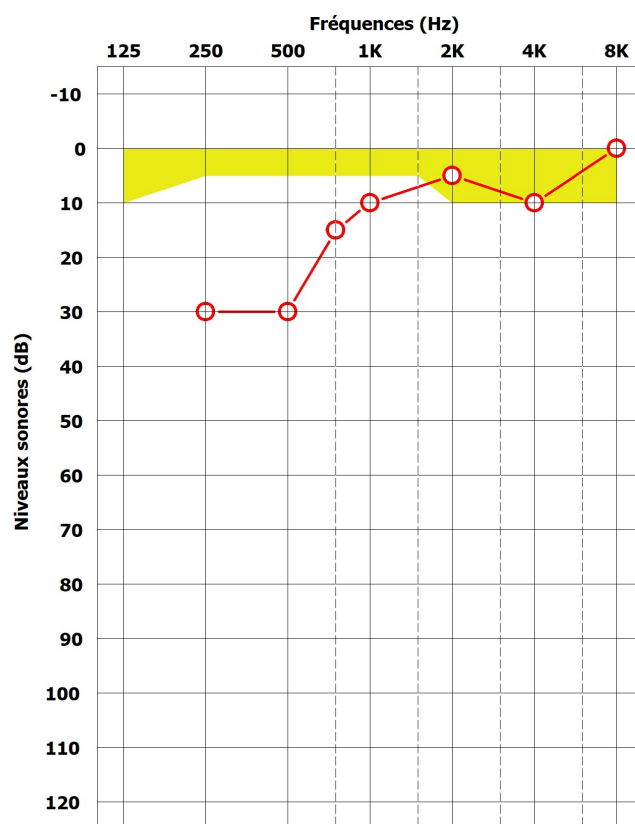

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	10	5		5		5		15
CA Droit		30	30	15	10		5		10		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	SACKO NOUHAN
Date de naissance	27/08/2000
Age	24
Société	CR18
ID	24100113105570207

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021