

MEDVIE


Date du test: 05/08/2025 17:10:27

Durée: 6mn 01s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CISSE SALIFOU
Date de naissance	22/05/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25080517065562832

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

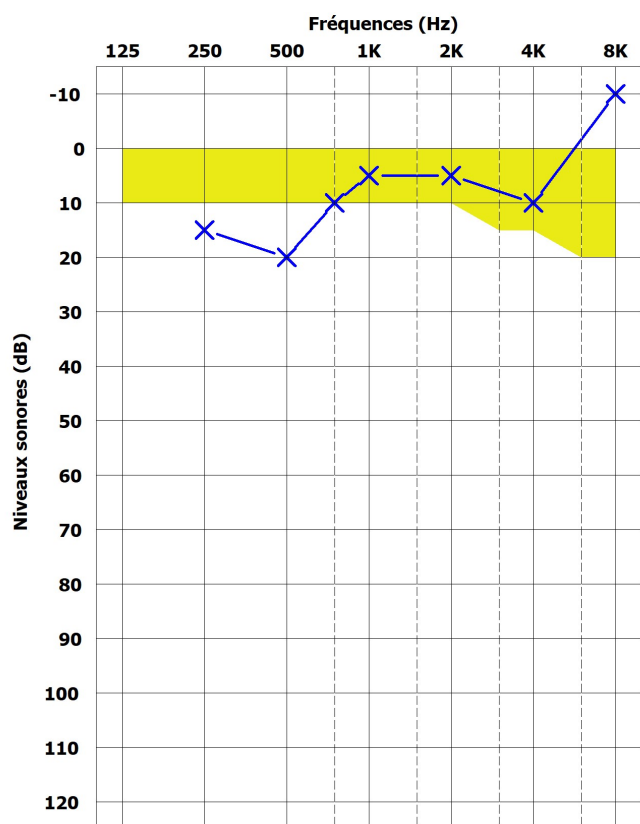

Oreille Gauche

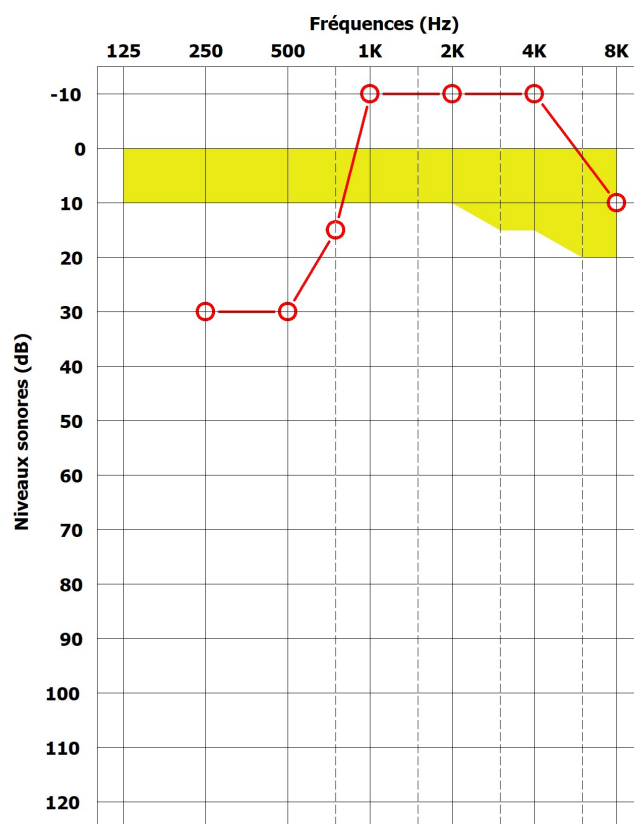

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	10	5		5		10		-10
CA Droit		30	30	15	-10		-10		-10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes