


MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 11:01:29

Durée: 5mn 59s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

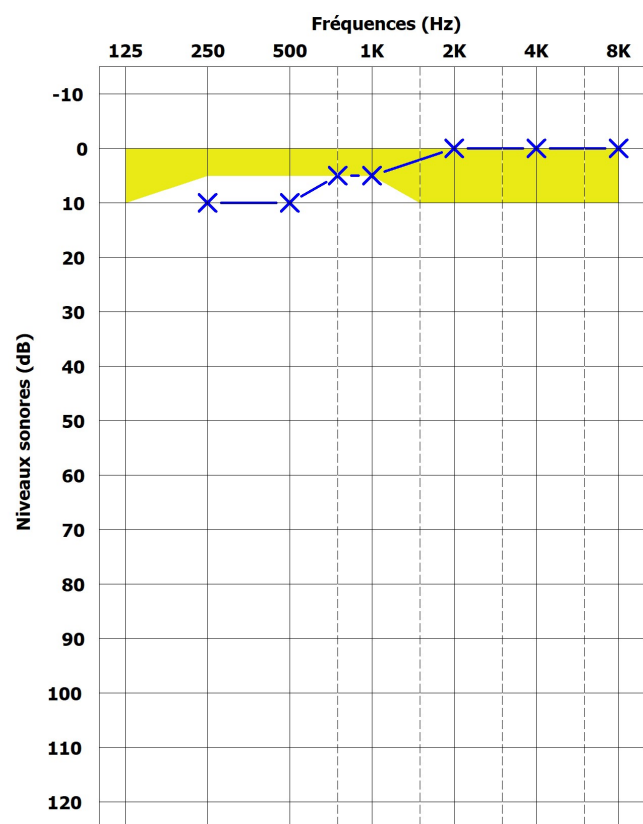

Oreille Gauche

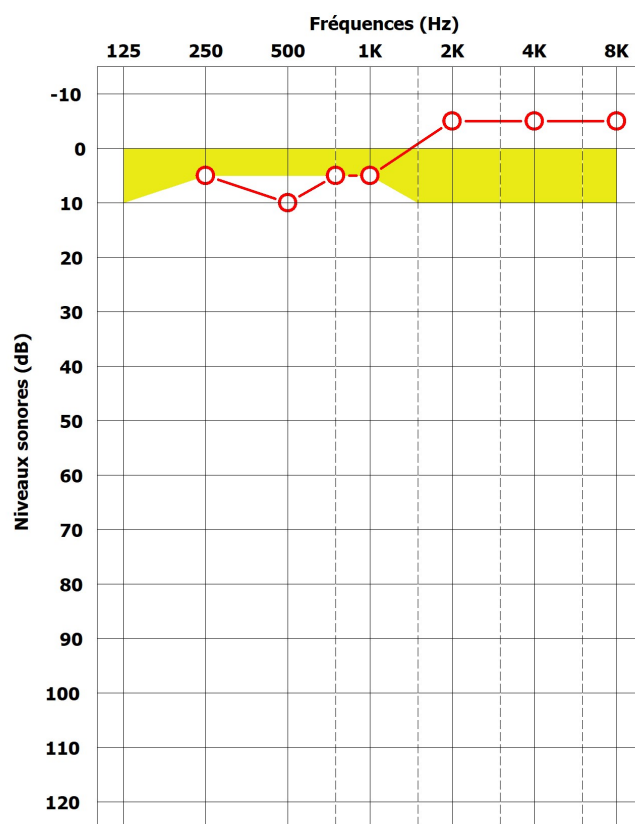

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	5	5		0		0		0
CA Droit		5	10	5	5		-5		-5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	3,8 dB	---
CA Droit	1,3 dB	---

Notes

Données Patient

IENGUANO SAA
NORRERT

Date de naissance

01/01/1997

Age

27

Société

CR18

ID

24093010541413815

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021