



Données Patient		BAMBA LAYE
Date de naissance	01/01/1997	
Age	28	
Société	CR18	
ID	25011014421763456	

Date du test: 10/01/2025 14:46:20
Durée: 2mn 15s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

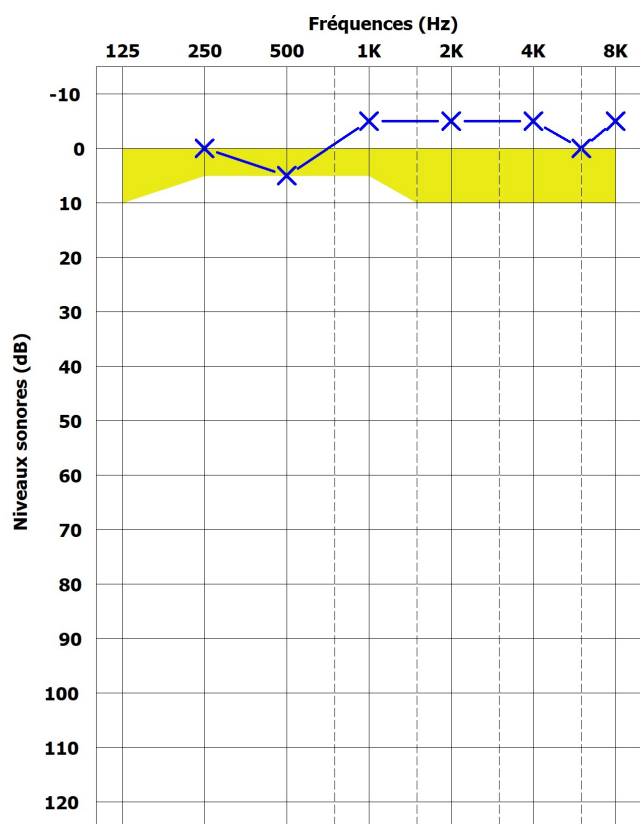

Oreille Gauche

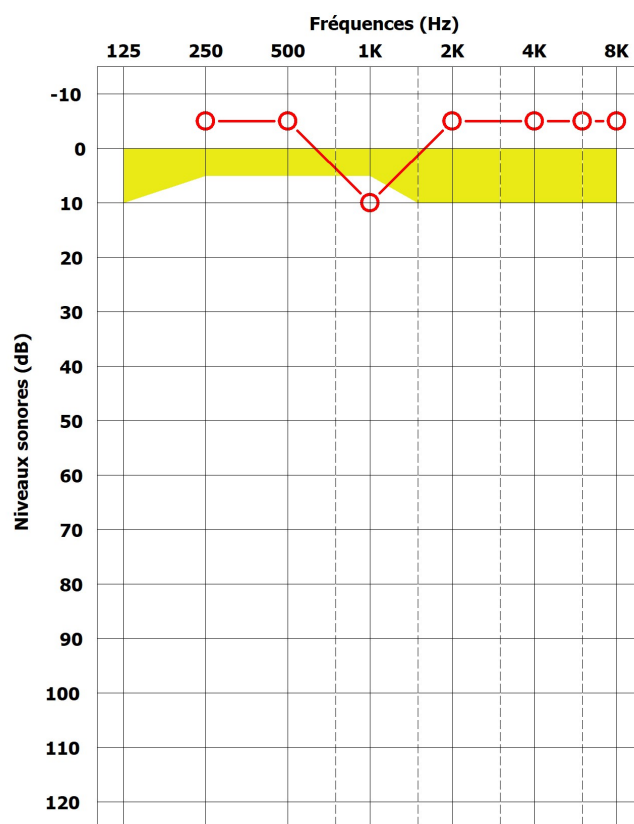

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5		-5		-5		-5	0	-5
CA Droit		-5	-5		10		-5		-5	-5	-5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	-5,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes