

Données Patient


DIAKITE KABINET II

Date de naissance 11/05/1996
Age 27
Société MV/CR18/285
ID 24040211260117584


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 02/04/2024 11:29:01
Durée: 2mn 54s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

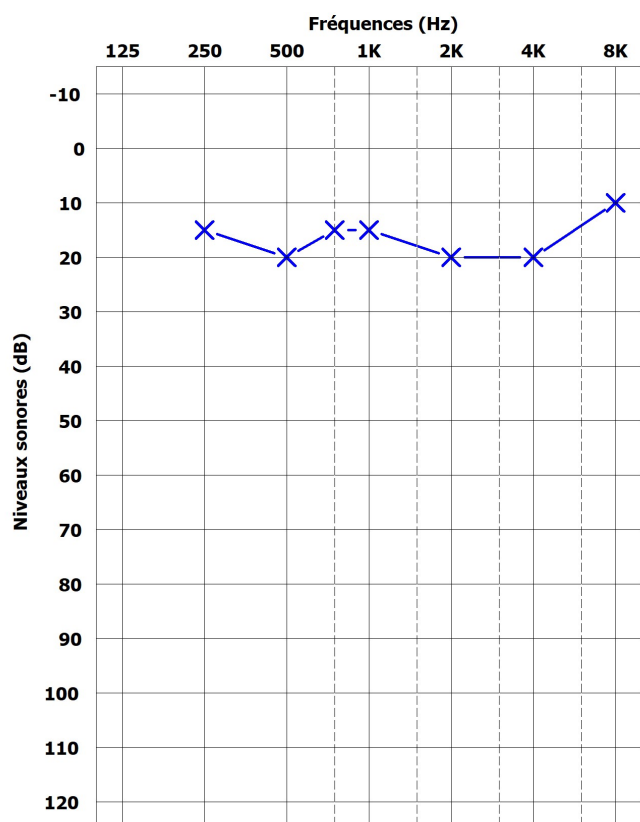

Oreille Gauche

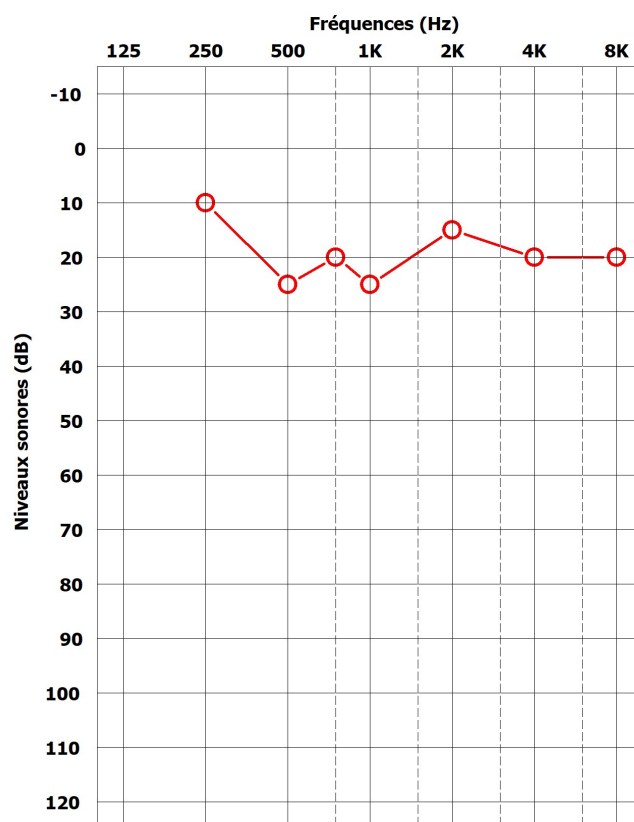

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		20		20		10
CA Droit		10	25	20	25		15		20		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes