


MEDVIE


Date du test: 31/05/2024 16:42:23
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	SYLLA FODE
Date de naissance	01/01/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24053116404987068

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

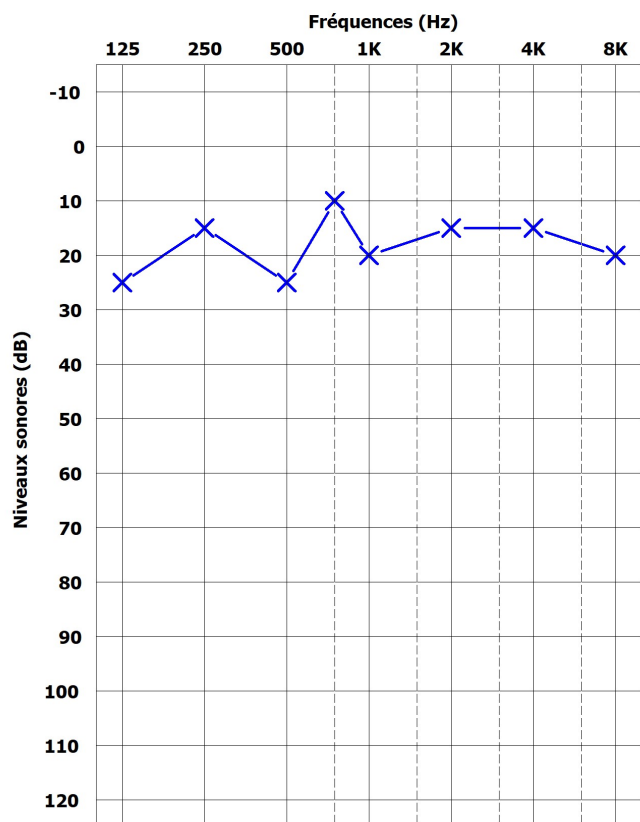

Oreille Gauche

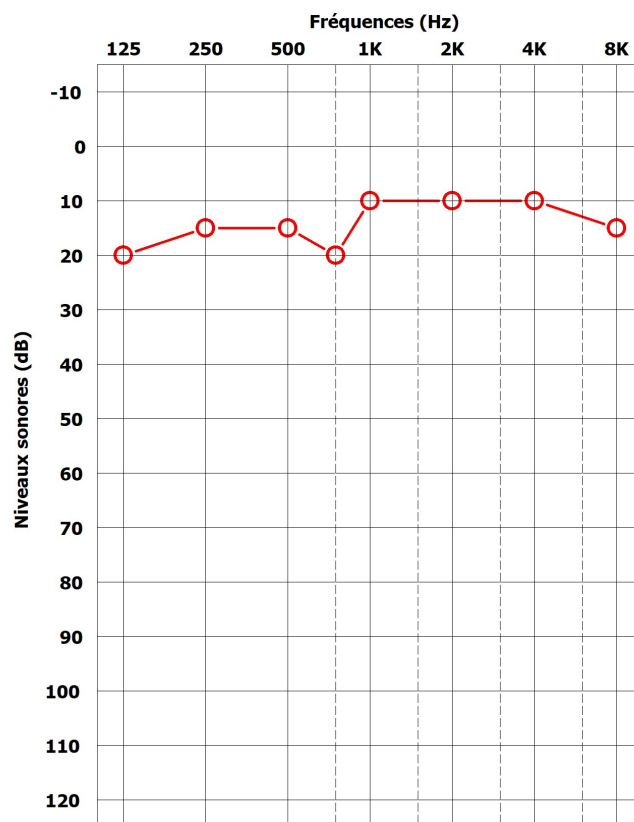

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	25	10	20		15		15		20
CA Droit	20	15	15	20	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes