


MEDVIE


Date du test: 01/07/2025 17:12:22  
Durée: 4mn 22s  
Type test: Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | DIALLO MAMADOU OURY |
|-------------------|---------------------|
| Date de naissance | 15/10/2002          |
| Age               | 22                  |
| Société           | CR18                |
| ID                | 25070117085529395   |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

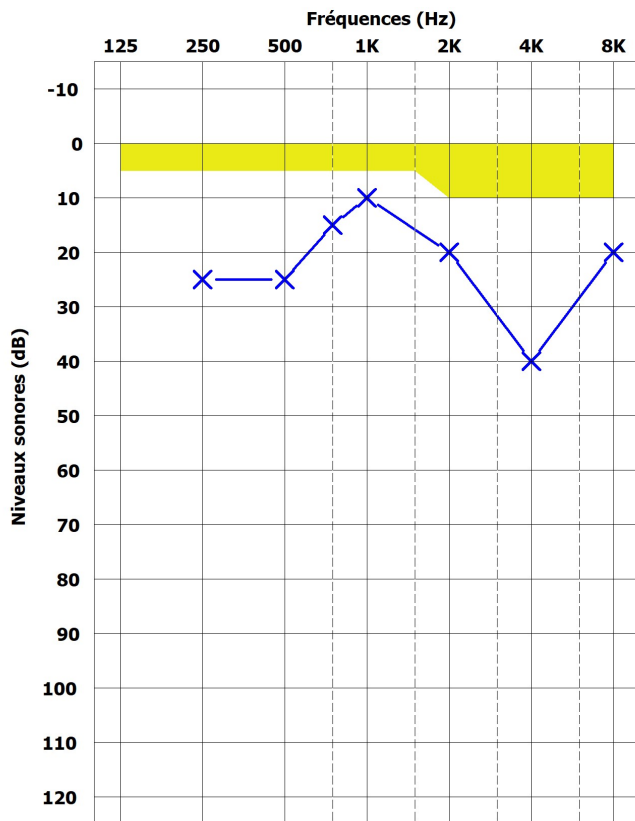

Oreille Gauche

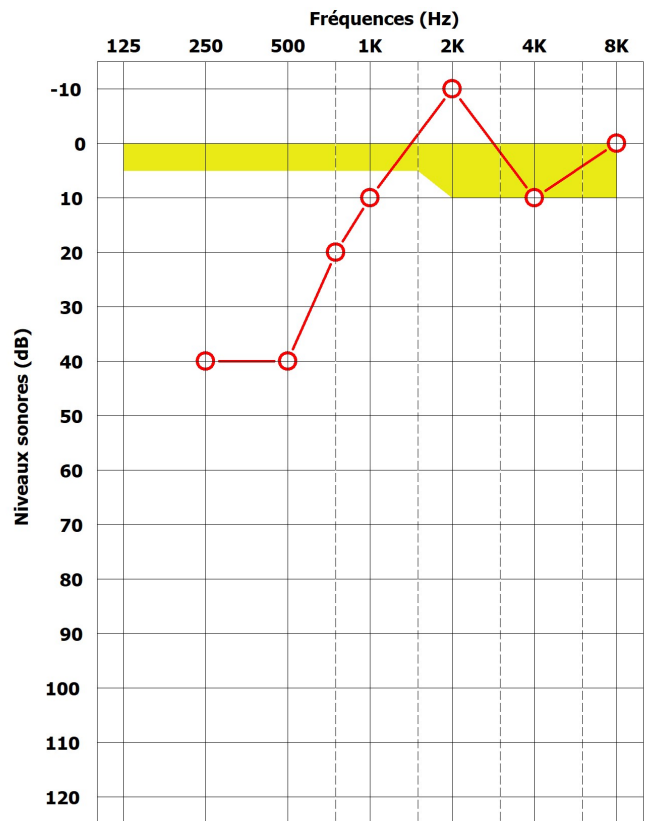

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k  | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 25  | 15  | 10 |     | 20  |    | 40 |    | 20 |
| CA Droit  |     | 40  | 40  | 20  | 10 |     | -10 |    | 10 |    | 0  |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 23,8 dB | --- |
| CA Droit        | 12,5 dB | --- |

Notes