

MEDVIE

Date du test: 12/03/2025 13:00:58

Durée: 5mn 52s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CISSE ABOUBACAR

Date de naissance 01/01/1990

Age 35

Société CR18


ID 25031212592114729

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690092

Date Calibration : 30/11/2021

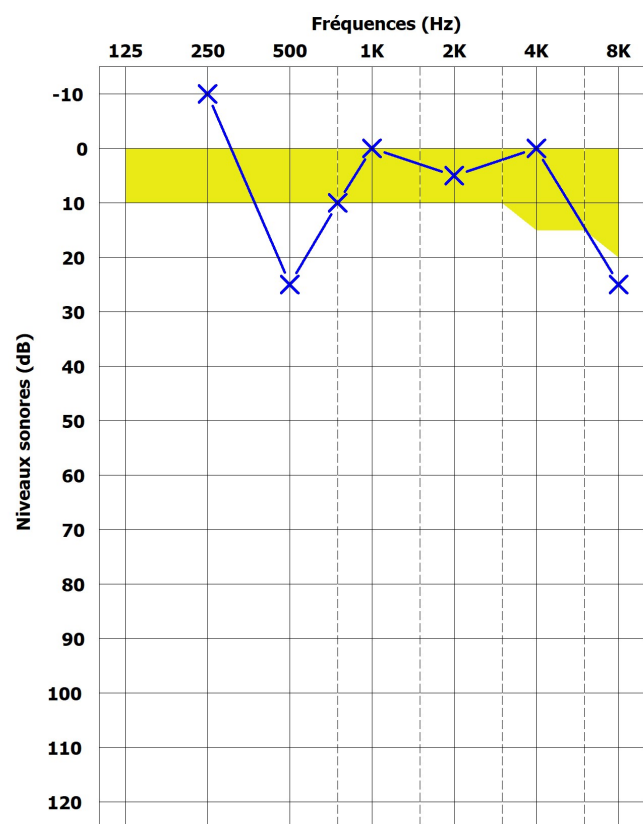

Oreille Gauche

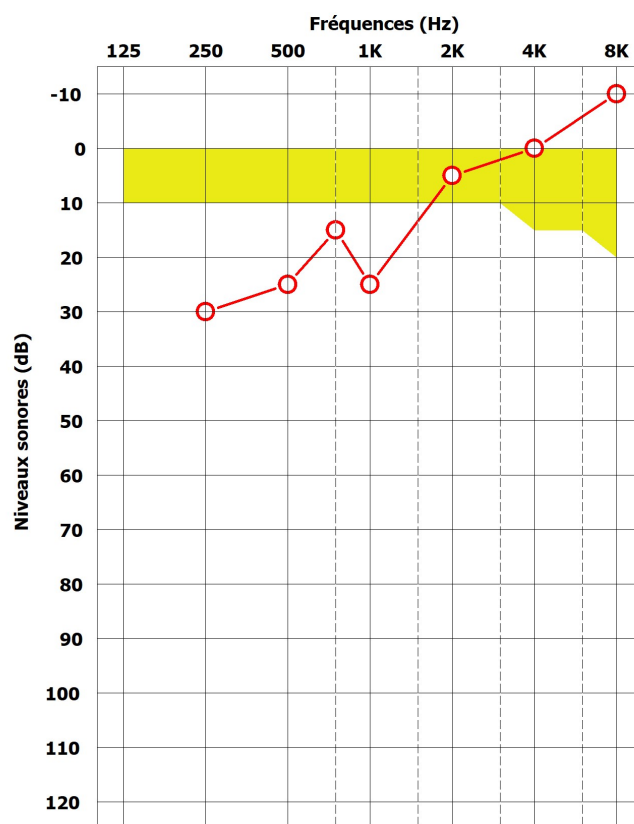

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	25	10	0		5		0		25
CA Droit		30	25	15	25		5		0		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes