


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 12:26:51
Durée: 4mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CISSE MUHAMED SALIOU	
Date de naissance	01/01/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25031412212631892

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

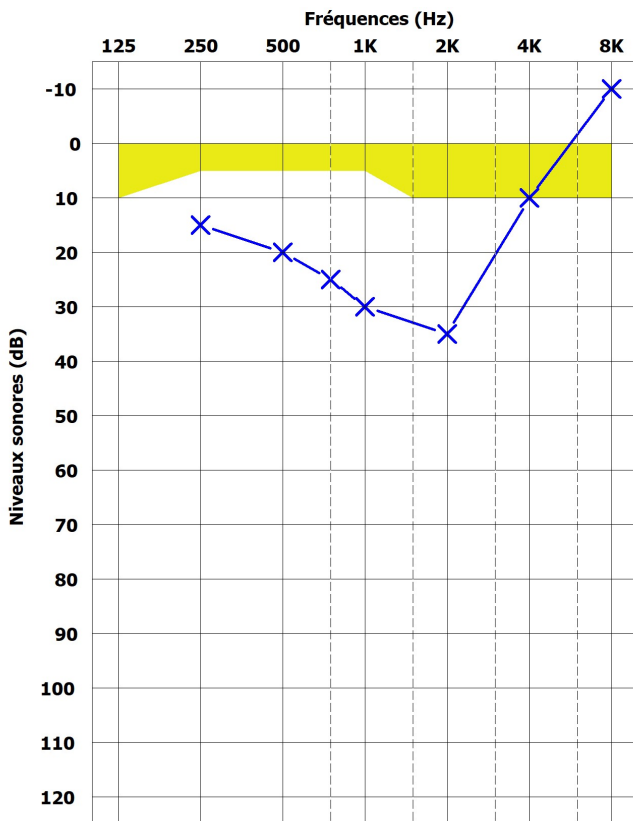

Oreille Gauche

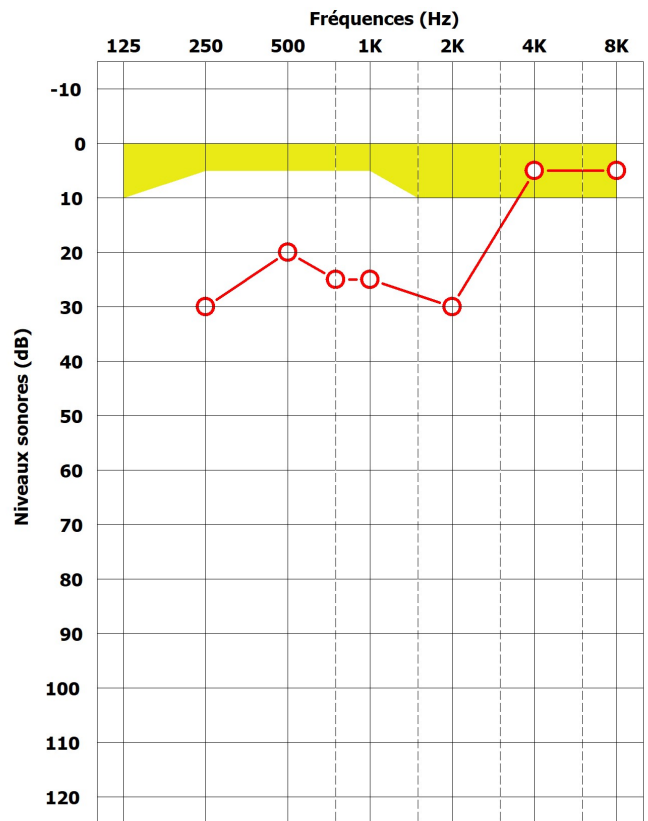

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	30		35		10		-10
CA Droit		30	20	25	25		30		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes