


Données Patient
CONDE OUSMANE

Date de naissance 01/01/1986
 Age 38
 Société CR18
 ID 24052012531977330


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
 Numéro de série: 2111EAT690093
 Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 20/05/2024 12:58:38
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

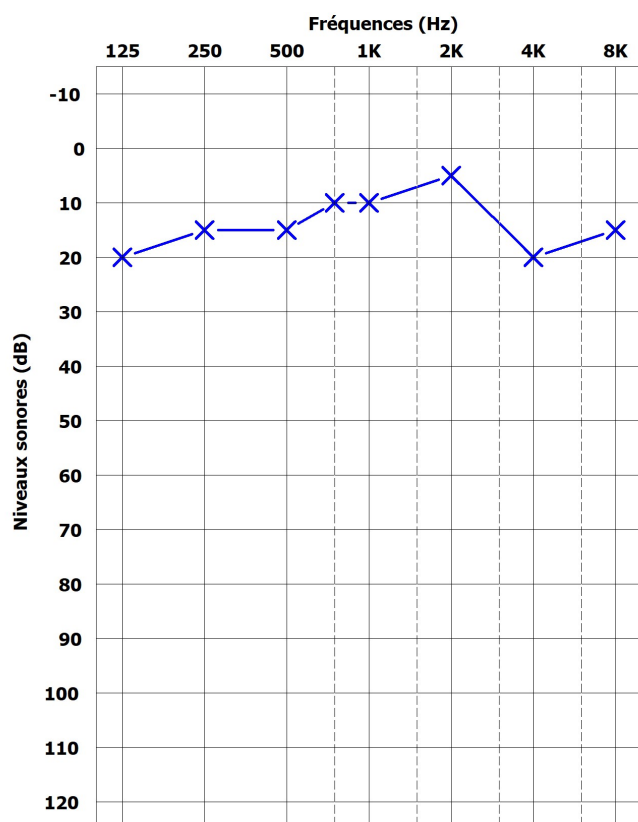

Oreille Gauche

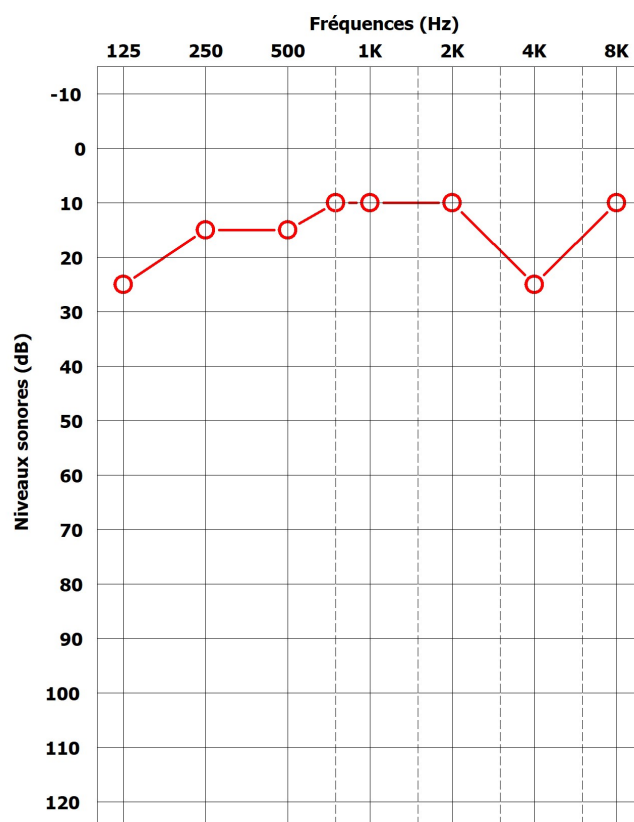

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	10	10		5		20		15
CA Droit	25	15	15	10	10		10		25		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes