

Données Patient


CAMARA SEKOU

Date de naissance 01/01/2001
Age 23
Société CR18
ID 24050719232392238


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 07/05/2024 19:26:48
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

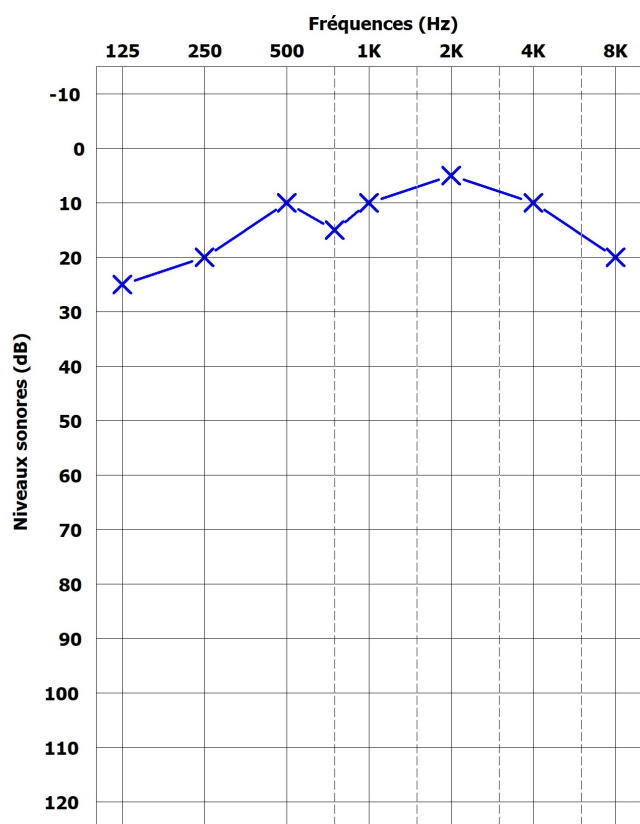

Oreille Gauche

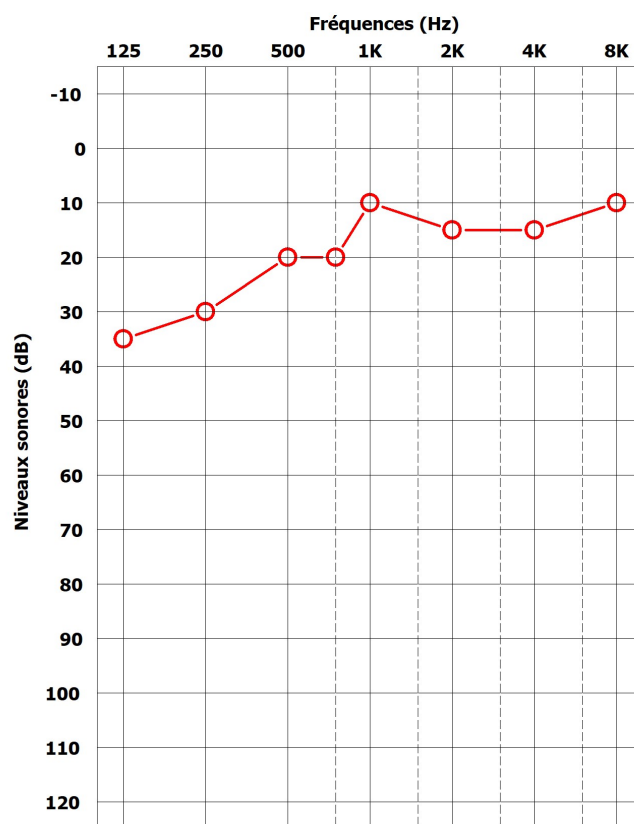

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	10	15	10		5		10		20
CA Droit	35	30	20	20	10		15		15		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes