



MEDVIE

Date du test: 08/07/2025 12:24:22
Durée: 4mn 59s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

ZAHANPENG CHE

Date de naissance

19/03/1999

Age

26

Société

CR18

ID

25070812194786750

Audiomètre

Type:


Audio 820M V2,211

Numéro de série:


2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021

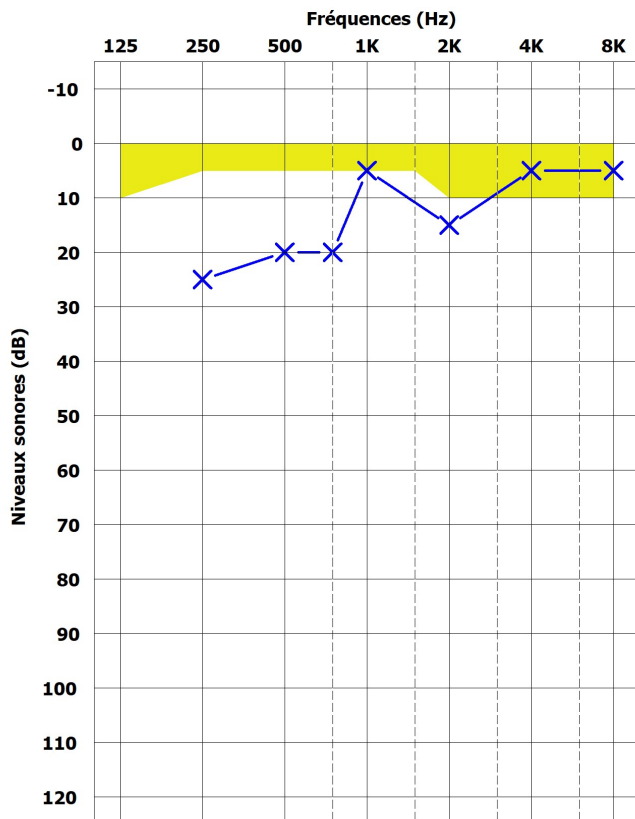

Oreille Gauche

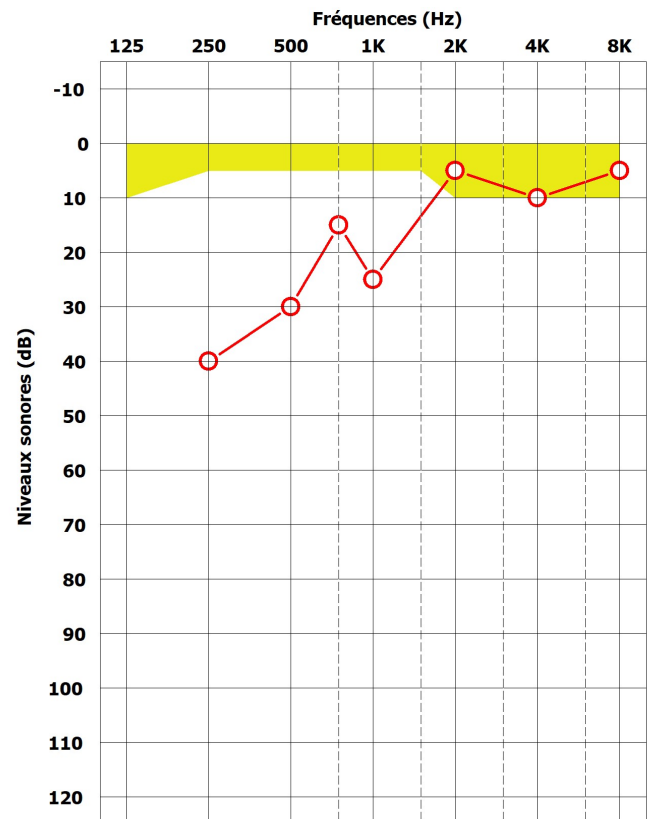

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	20	5		15		5		5
CA Droit		40	30	15	25		5		10		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes