


MEDVIE


Date du test: 04/03/2024 15:51:11
Durée: 6mn 39s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAWARA BANGALY	
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CR18
ID	24030415474988984

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

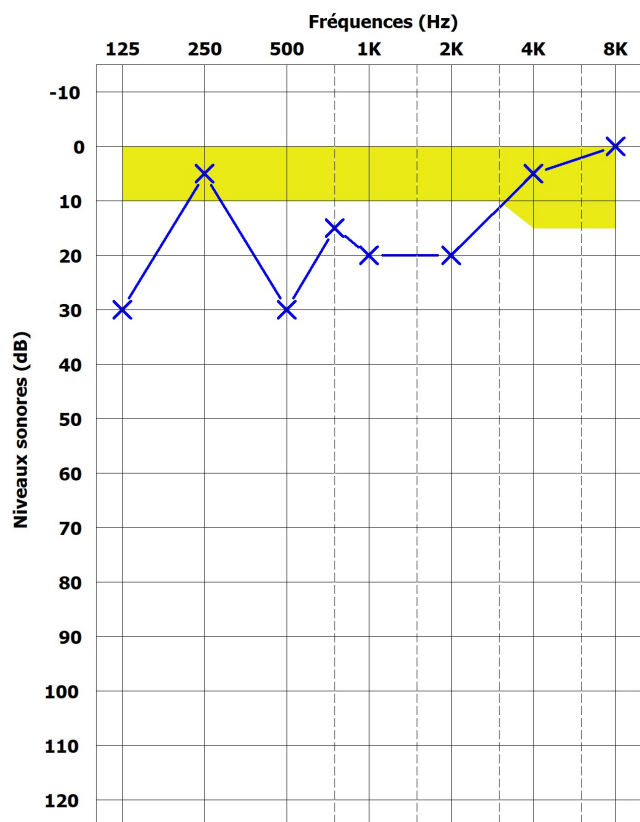

Oreille Gauche

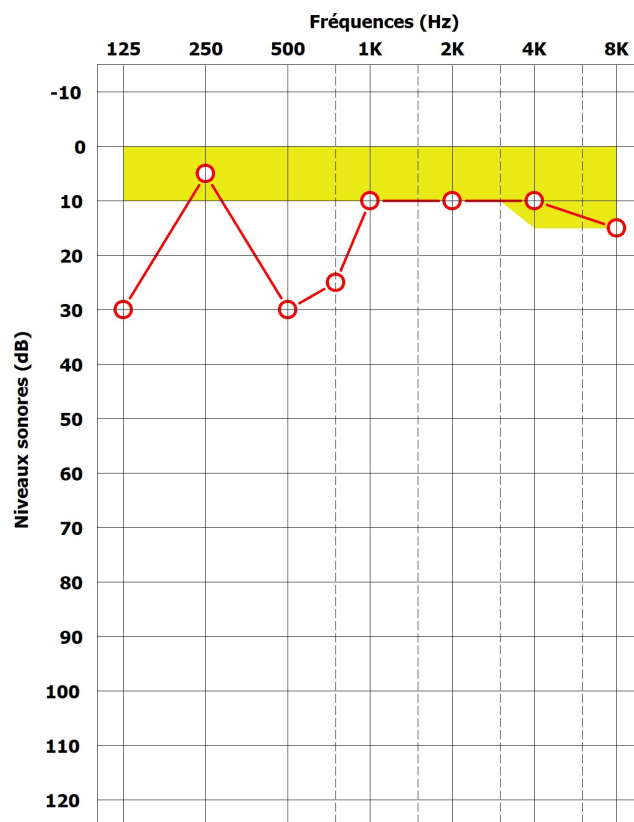

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	5	30	15	20		20		5		0
CA Droit	30	5	30	25	10		10		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes