


MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 13:19:53

Durée: 7mn 51s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

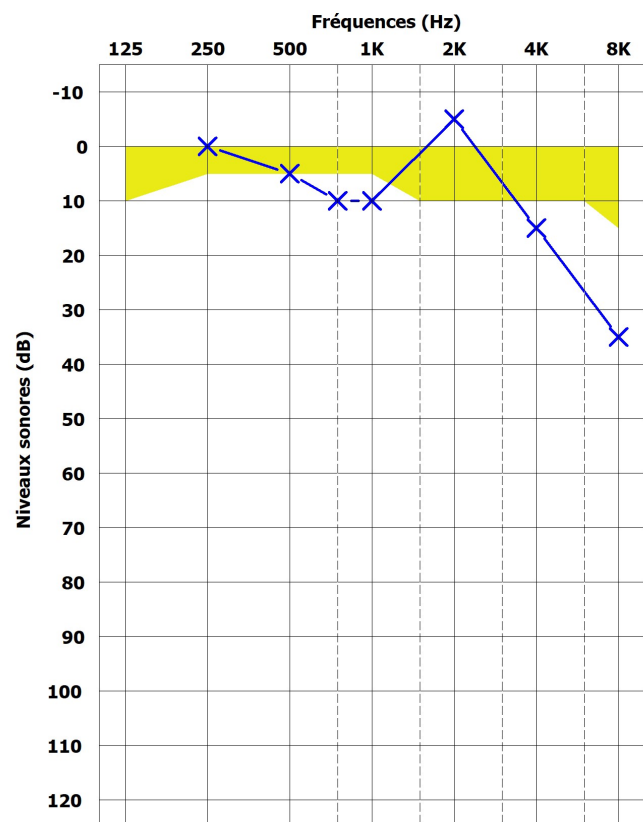

Oreille Gauche

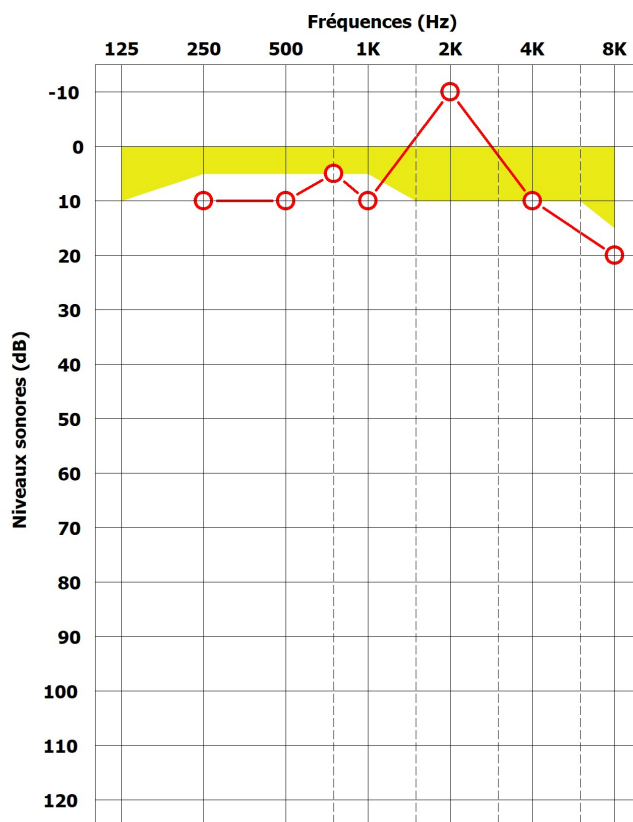

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	10	10		-5		15		35
CA Droit		10	10	5	10		-10		10		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	5,0 dB	---

Notes

Données Patient

CAMARA MORY

Date de naissance

01/01/1995

Age

29

Société

CR18

ID

24100313095232973

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021