

MEDVIE

Date du test: 16/05/2024 09:09:39

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

**CONDE ADAMA**

Date de naissance 01/01/2005

Age 19

Société CR18


ID 24051609054240755

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

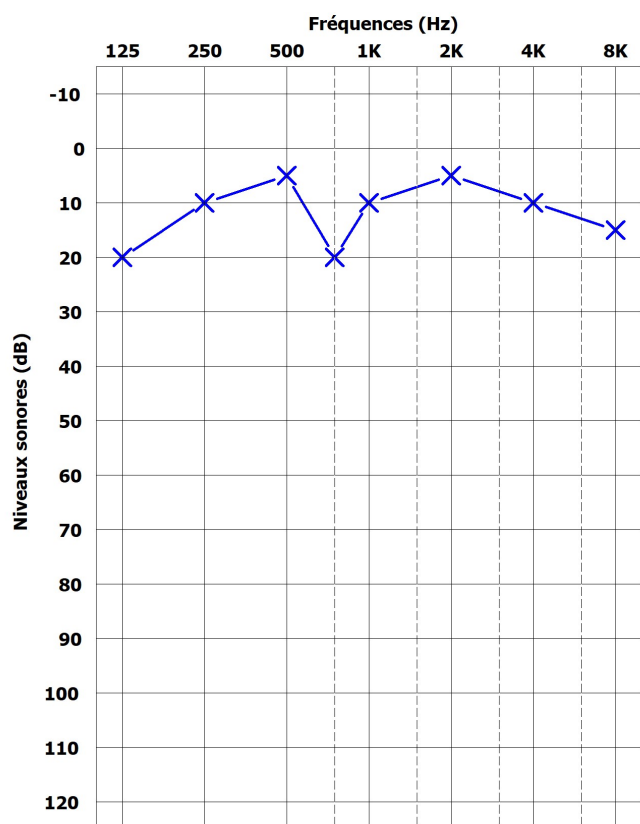

Oreille Gauche

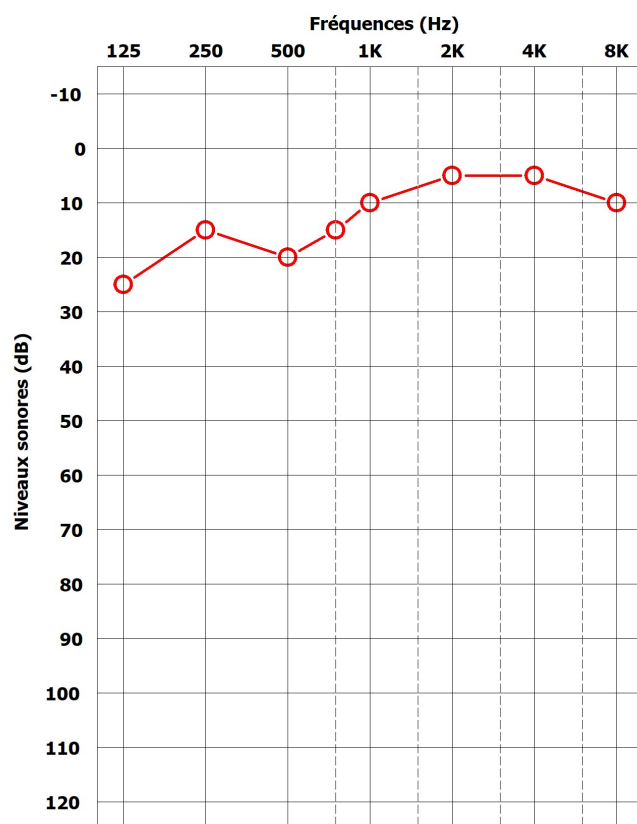

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 10  | 5   | 20  | 10 |     | 5  |    | 10 |    | 15 |
| CA Droit  | 25  | 15  | 20  | 15  | 10 |     | 5  |    | 5  |    | 10 |

Calcul de perte

|           | PAM     | IPA |
|-----------|---------|-----|
| CA Gauche | 7,5 dB  | --- |
| CA Droit  | 10,0 dB | --- |

Notes