

MEDVIE


Date du test: 20/03/2025 12:35:29

Durée: 3mn 41s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
JIANG WEIYANG	
Date de naissance	19/02/1990
Age	35
Société	CR18
ID	25032012334338431

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

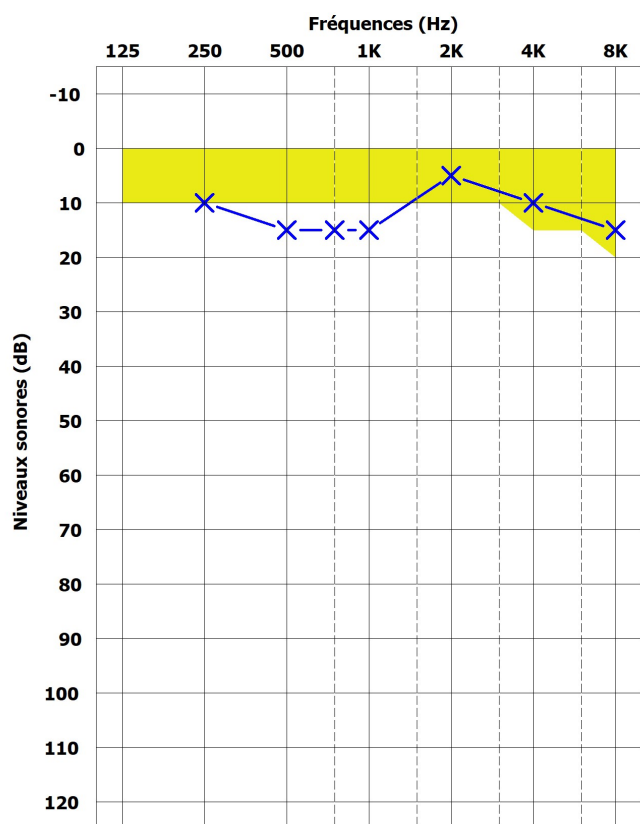

Oreille Gauche

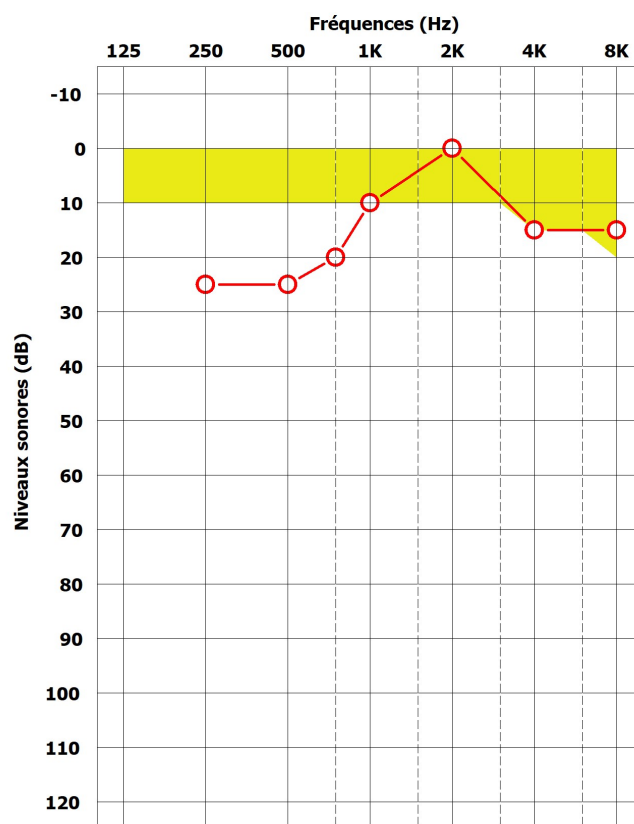

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	15	15		5		10		15
CA Droit		25	25	20	10		0		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes