


MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 13:57:39
Durée: 9mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	07/01/1981
Age	43
Société	CR18
ID	24042913551599412

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

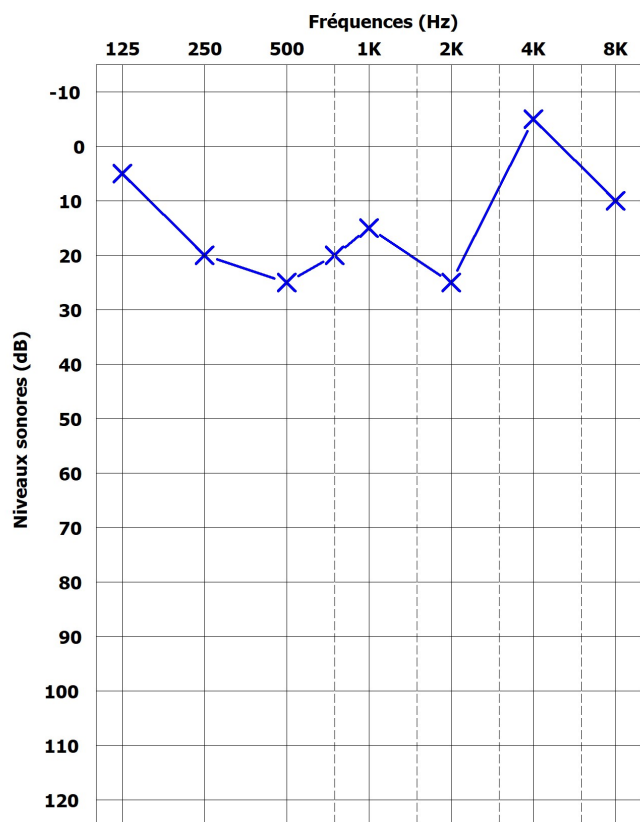

Oreille Gauche

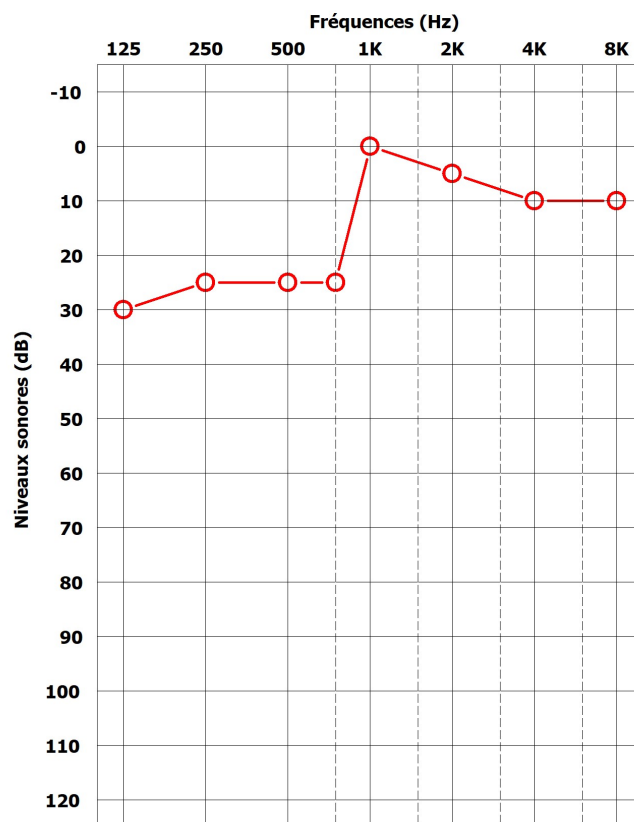

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	5	20	25	20	15		25		-5		10
CA Droit	30	25	25	25	0		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes