

Données Patient


TRAORE BOYE

Date de naissance 01/01/1997
Age 27
Société CR18
ID 24050814042705531


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 08/05/2024 14:11:34
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

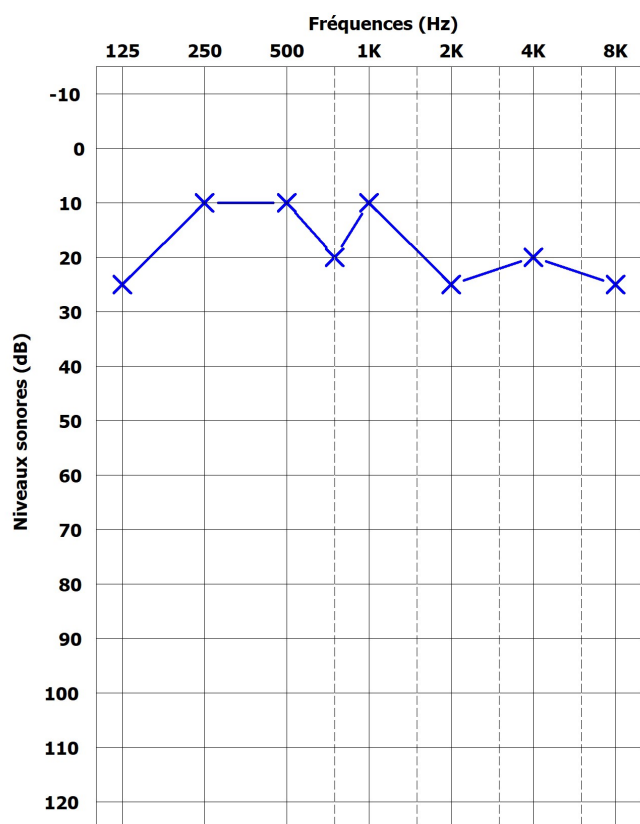

Oreille Gauche

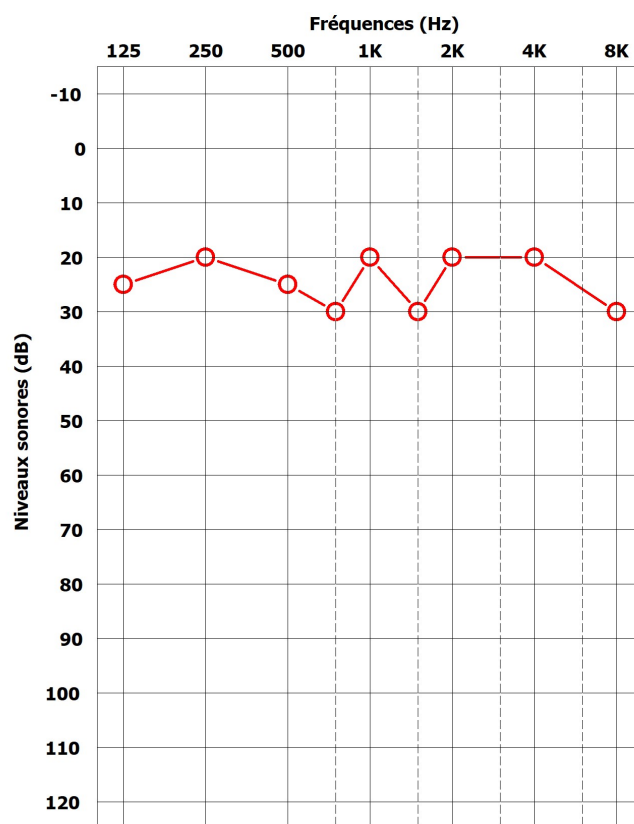

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	10	10	20	10		25		20		25
CA Droit	25	20	25	30	20	30	20		20		30

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes