

MEDVIE

Date du test: 01/06/2024 13:36:16


Durée: -- mn -- s

Type test Manuel


Continu

| Données Patient        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>KOUROUMA MAMADY</b> |                   |
| Date de naissance      | 01/07/1993        |
| Age                    | 30                |
| Société                | CR18              |
| ID                     | 24060113330973806 |

| Audiomètre         |                   |
|--------------------|-------------------|
| Type:              | Audio 820M V2,211 |
| Numéro de série:   | 2111EAT690093     |
| Date Calibration : | 30/11/2021        |

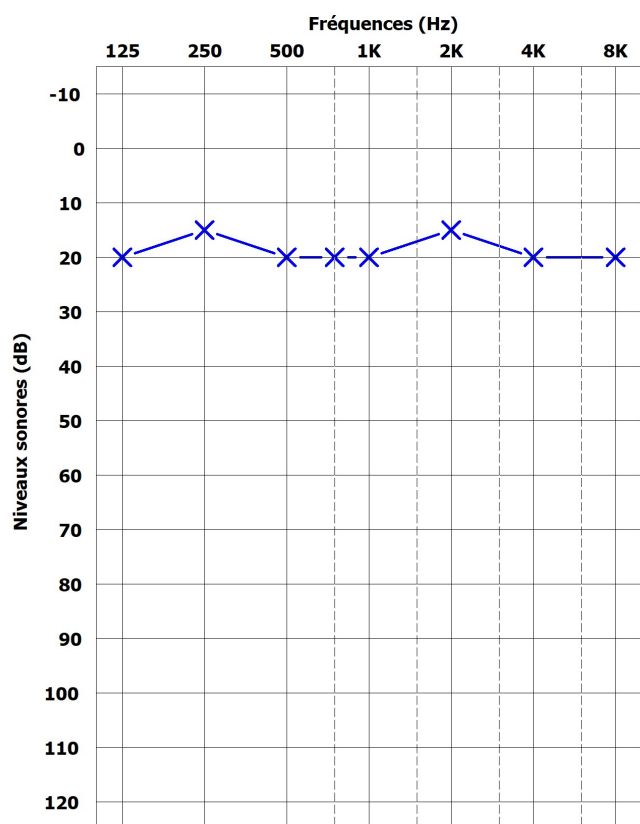

Oreille Gauche

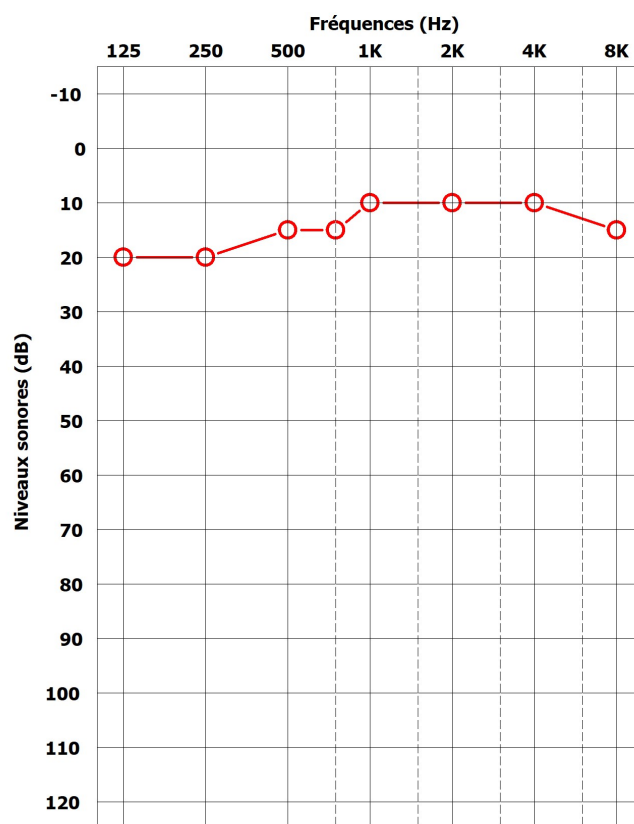

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche | 20  | 15  | 20  | 20  | 20 |     | 15 |    | 20 |    | 20 |
| CA Droit  | 20  | 20  | 15  | 15  | 10 |     | 10 |    | 10 |    | 15 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 18,8 dB | --- |
| CA Droit        | 11,3 dB | --- |

Notes