


MEDVIE


Date du test: 05/08/2025 16:25:03
Durée: 3mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF HAROUNA	
Date de naissance	22/10/1984
Age	40
Société	CR18
ID	25080516220463231

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

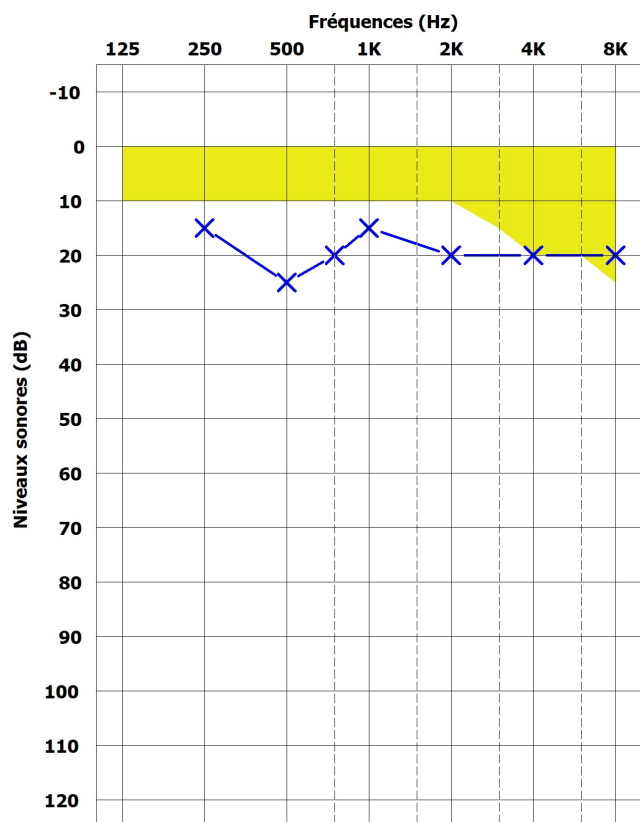

Oreille Gauche

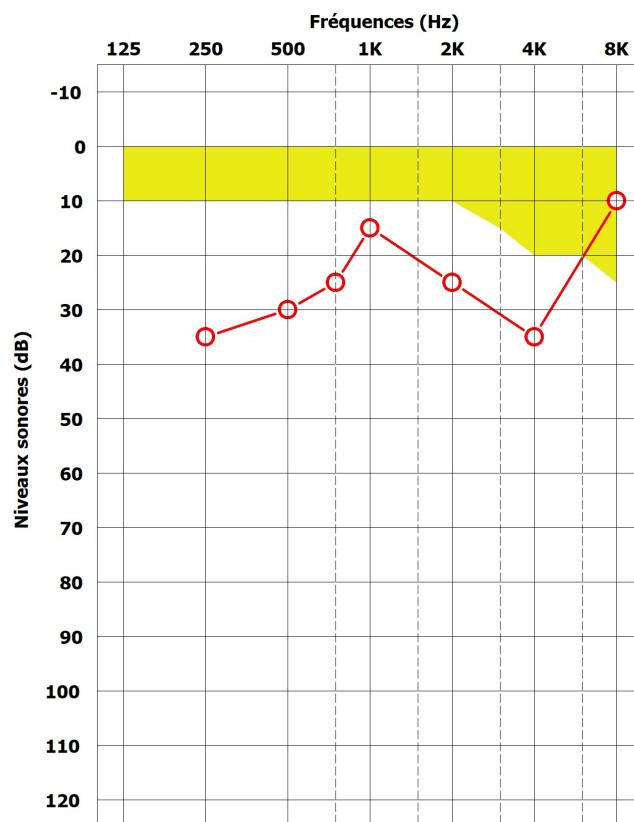

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	15		20		20		20
CA Droit		35	30	25	15		25		35		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes