



Données Patient		SOUARE N'GAFING
Date de naissance	01/01/2005	
Age	20	
Société	CR18	
ID	25011015005418470	

Date du test: 10/01/2025 15:03:05
Durée: 4mn 34s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

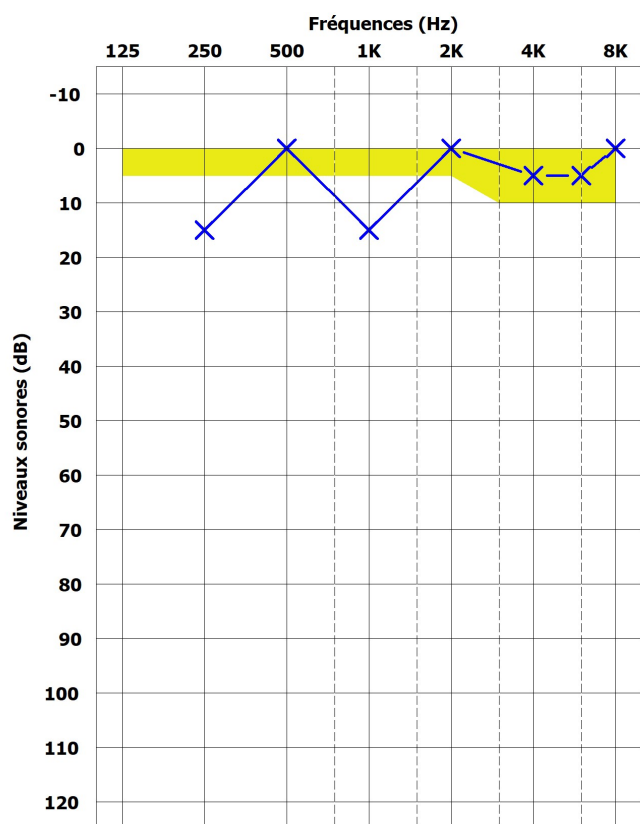

Oreille Gauche

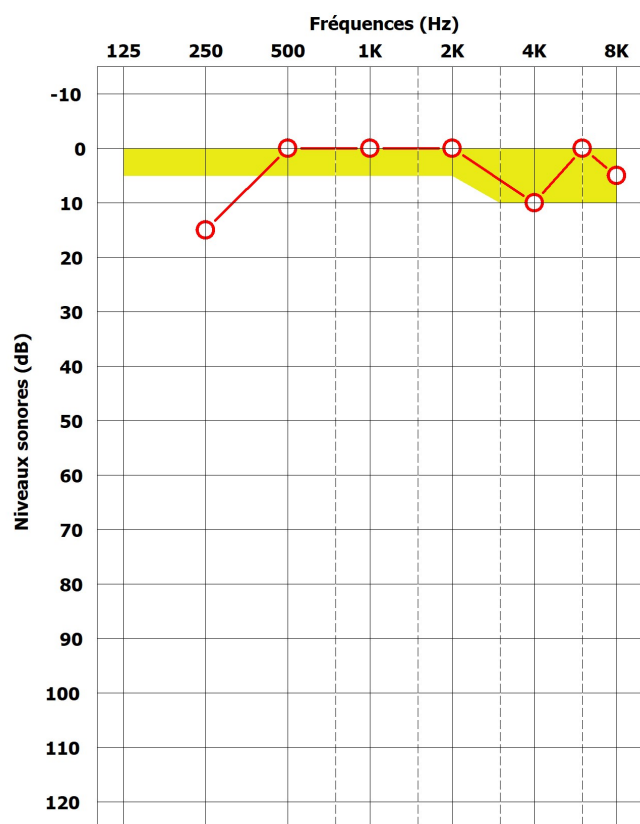

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	0		15		0		5	5	0
CA Droit		15	0		0		0		10	0	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes