


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 12:23:15
Durée: 3mn 52s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TRORE Fode
Date de naissance	01/01/1990	
Age	35	
Société	CR18	
ID	25031312213698447	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

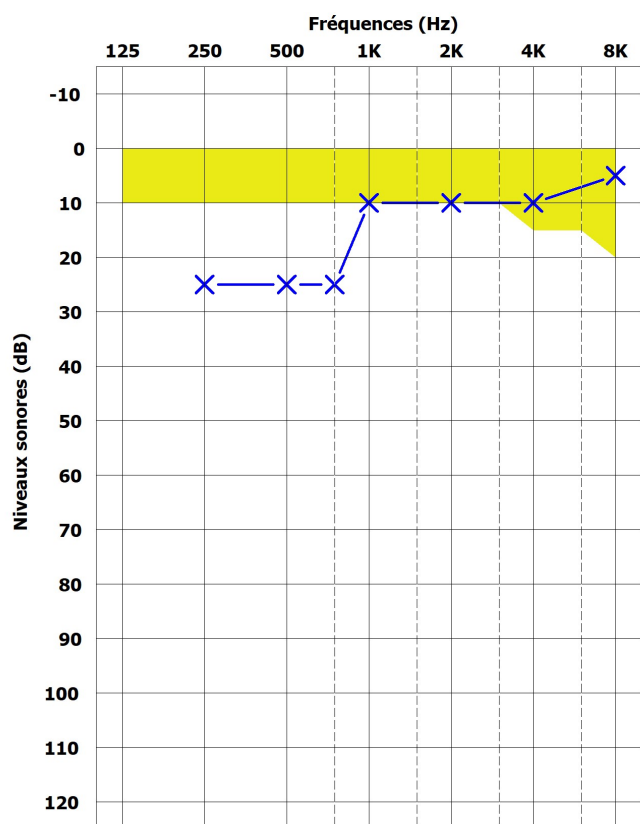

Oreille Gauche

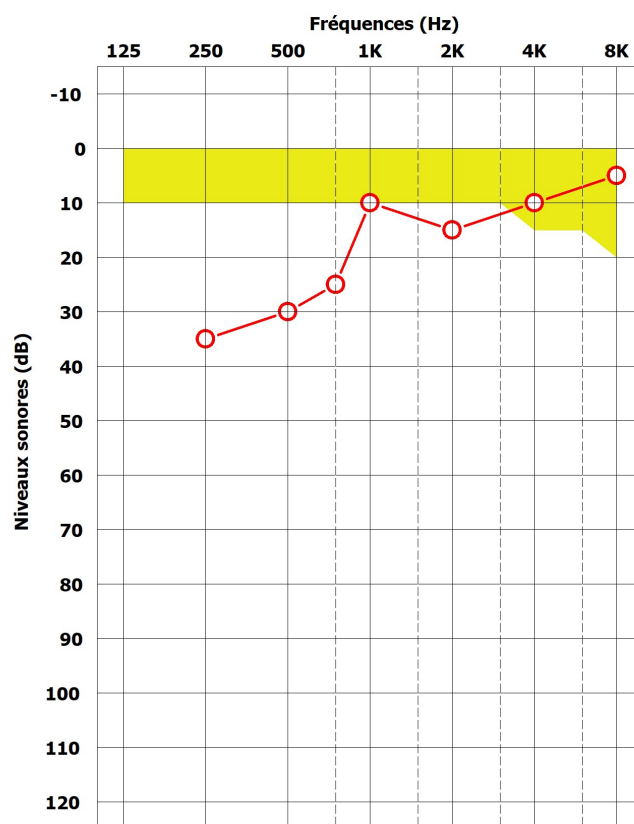

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	10		10		10		5
CA Droit		35	30	25	10		15		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes