

MEDVIE


Date du test: 15/05/2025 12:42:29

Durée: 4mn 35s


Type test  
Auto  
Normal  
Continu  
Scén. Standard

| Données Patient   | TRAORE VASIDIKI   |
|-------------------|-------------------|
| Date de naissance | 19/10/1977        |
| Age               | 47                |
| Société           | CR18              |
| ID                | 25051512393091687 |

| Audiomètre                     |
|--------------------------------|
| Type: Audio 820M V2,211        |
| Numéro de série: 2111EAT690092 |
| Date Calibration : 30/11/2021  |

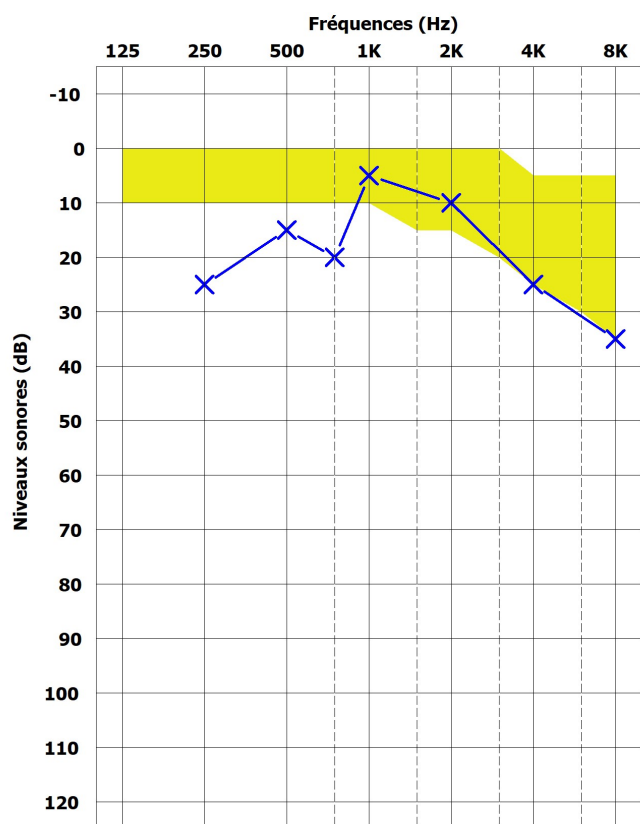

Oreille Gauche

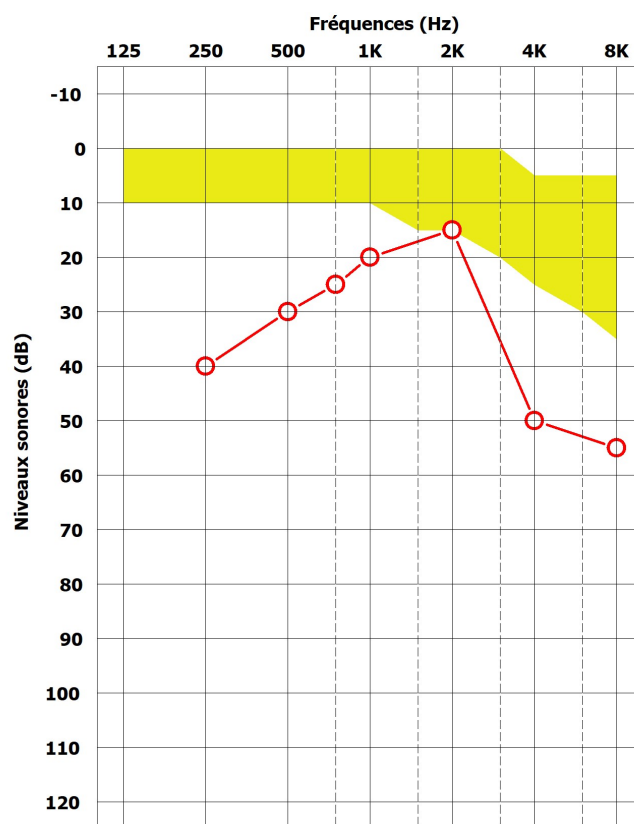

Oreille Droite

|           | 125 | 250 | 500 | 750 | 1k | 1k5 | 2k | 3k | 4k | 6k | 8k |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|----|----|
| CA Gauche |     | 25  | 15  | 20  | 5  |     | 10 |    | 25 |    | 35 |
| CA Droit  |     | 40  | 30  | 25  | 20 |     | 15 |    | 50 |    | 55 |

| Calcul de perte | PAM     | IPA |
|-----------------|---------|-----|
| CA Gauche       | 13,8 dB | --- |
| CA Droit        | 28,8 dB | --- |

Notes