

MEDVIE

Date du test: 24/05/2024 10:07:27

Durée: -- mn -- s

Type test Manuel

Continu

Données Patient

CAMARA MORY

Date de naissance 01/01/2002

Age 22

Société CR18


ID 24052410041620308

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

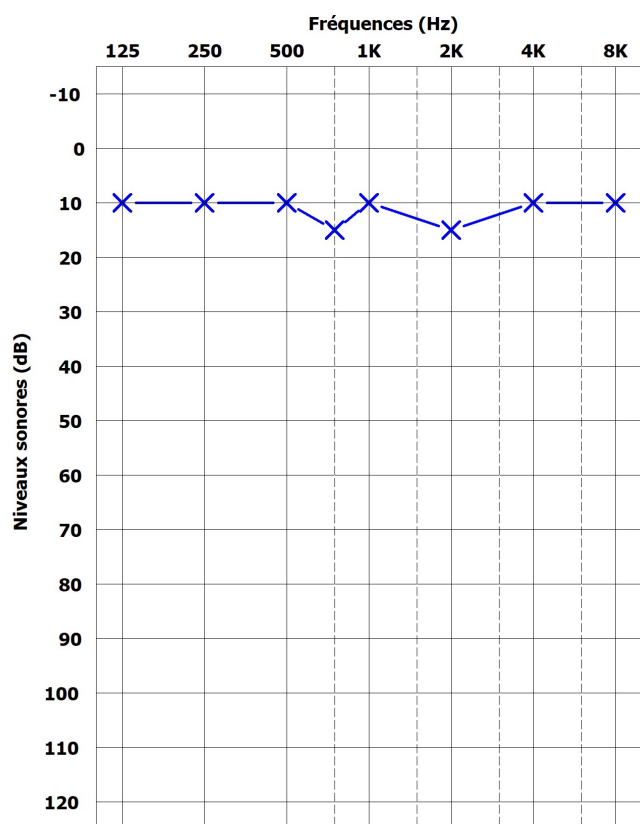

Oreille Gauche

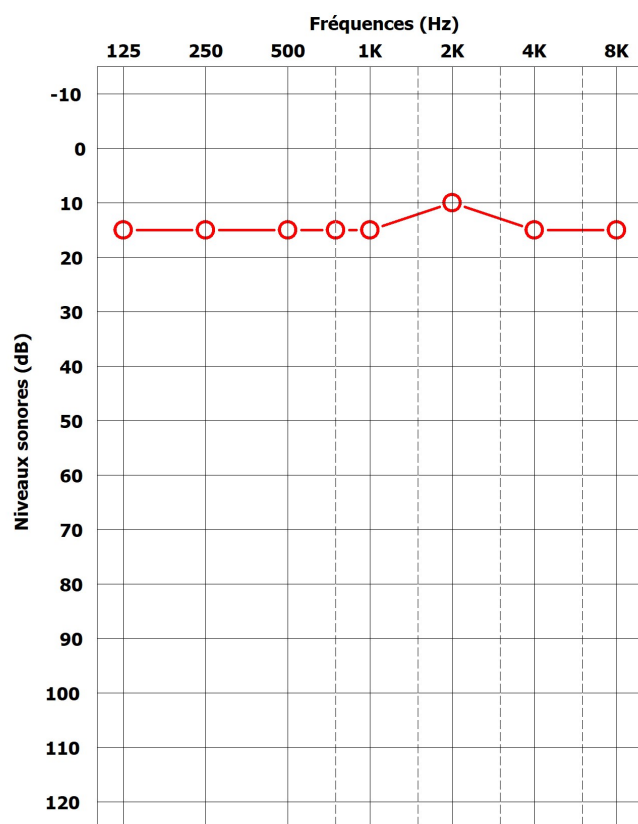

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	10	10	15	10		15		10		10
CA Droit	15	15	15	15	15		10		15		15

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes