

MEDVIE

Date du test: 01/05/2024 19:48:09

Durée: 6mn 16s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient

CAMARA FODE

Date de naissance 01/01/1994

Age 30

Société CR18


ID 24050119465227781

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

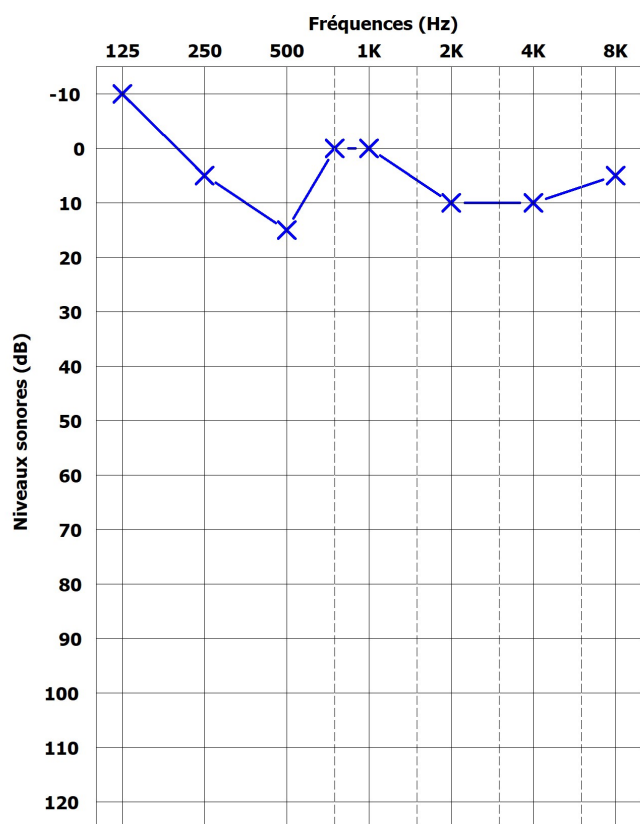

Oreille Gauche

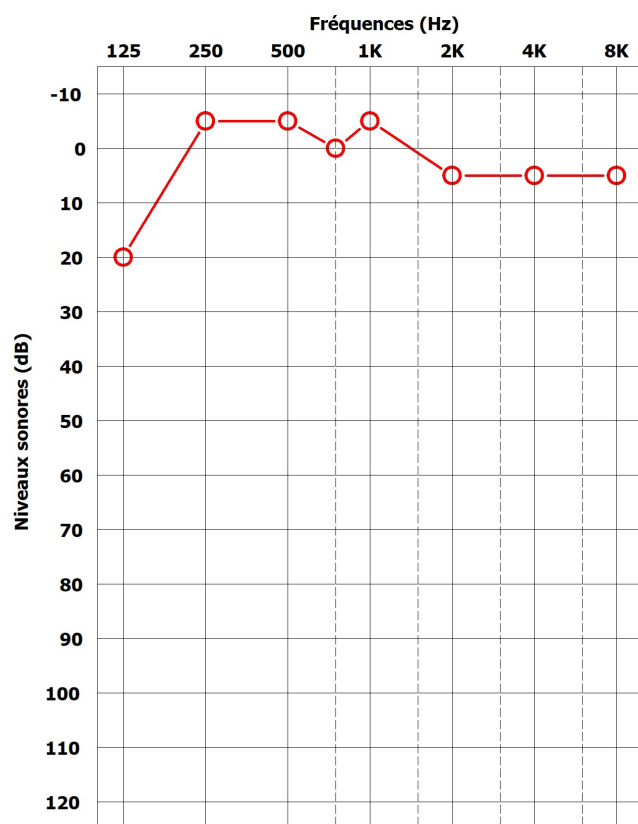

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-10	5	15	0	0		10		10		5
CA Droit	20	-5	-5	0	-5		5		5		5

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes