

Données Patient


KEITA ALIOU

Date de naissance 03/03/1988
Age 36
Société CR18
ID 25011014223793441


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 10/01/2025 14:28:20
Durée: 5mn 09s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

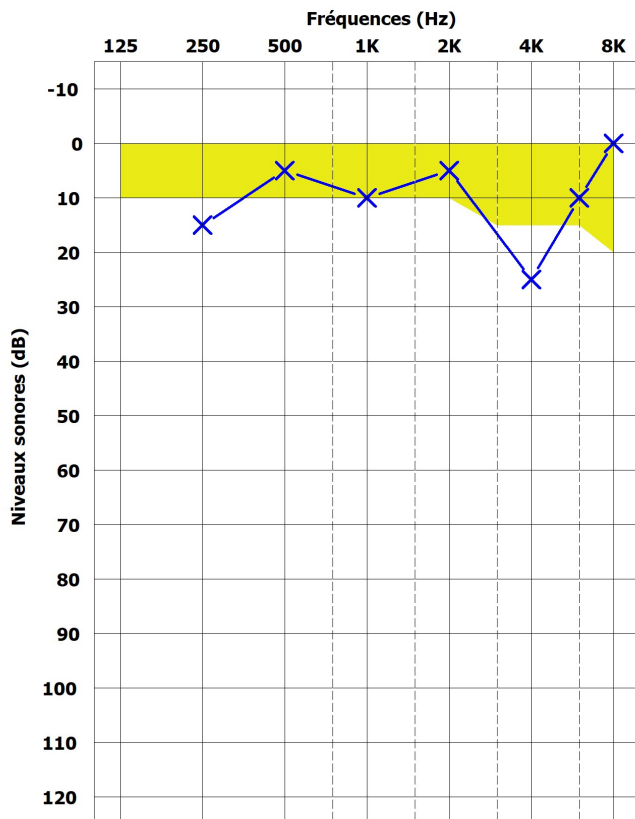

Oreille Gauche

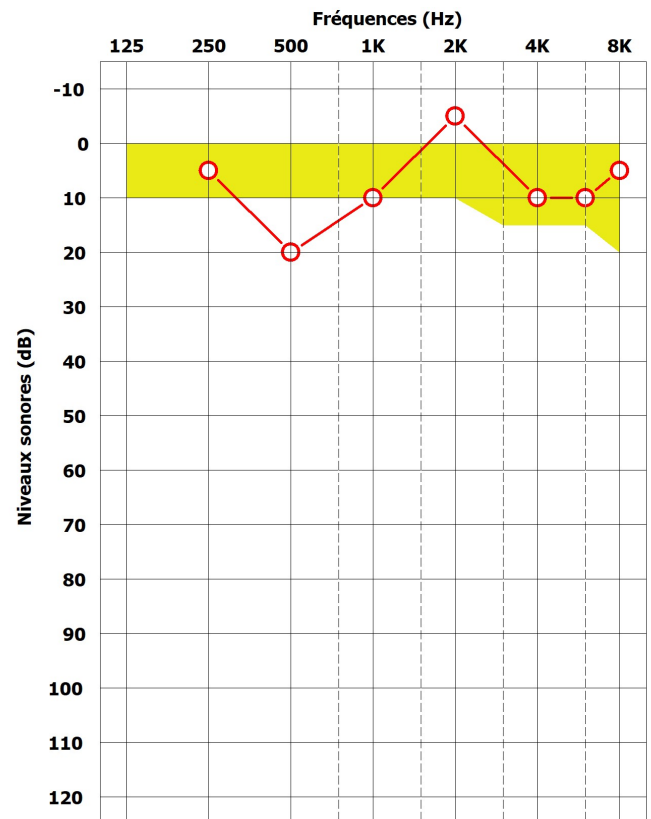

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	5		10		5		25	10	0
CA Droit		5	20		10		-5		10	10	5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes