


MEDVIE


Date du test: 03/04/2025 14:26:40
Durée: 4mn 07s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
ZHANG DAQING	
Date de naissance	04/12/1980
Age	44
Société	CR18
ID	25040314250584238

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

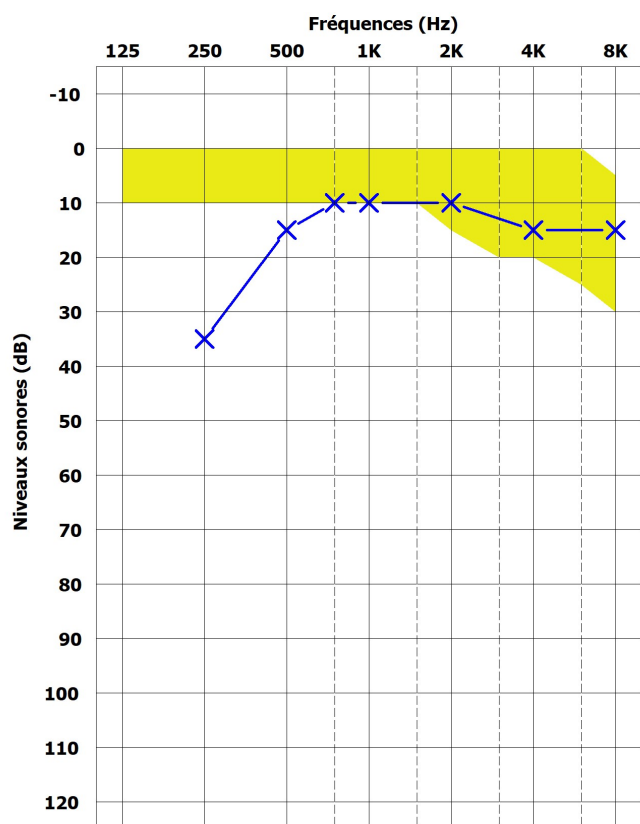

Oreille Gauche

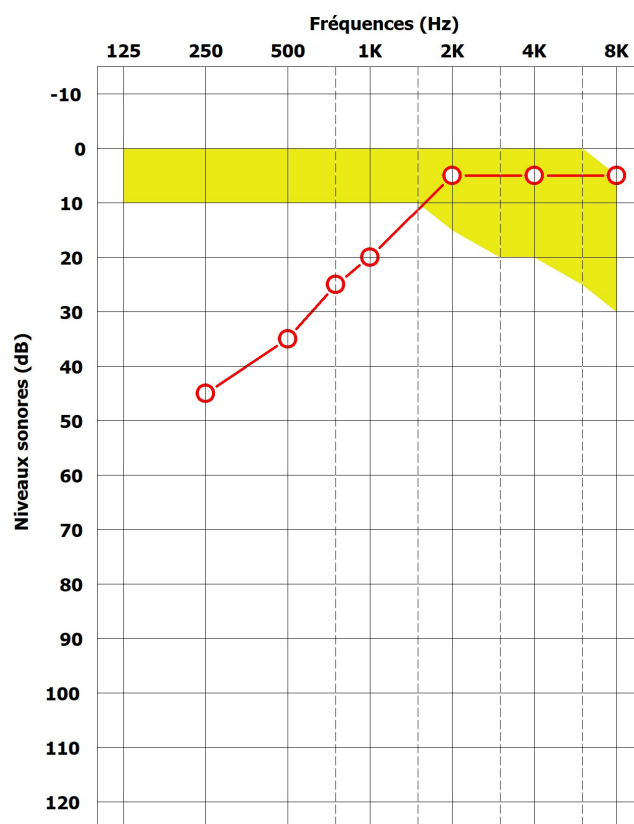

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		35	15	10	10		10		15		15
CA Droit		45	35	25	20		5		5		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes