

MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:30:53

Durée: 4mn 11s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CHERIF LAMINE	
Date de naissance	01/01/1979
Age	46
Société	CR18
ID	25031412510941708

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

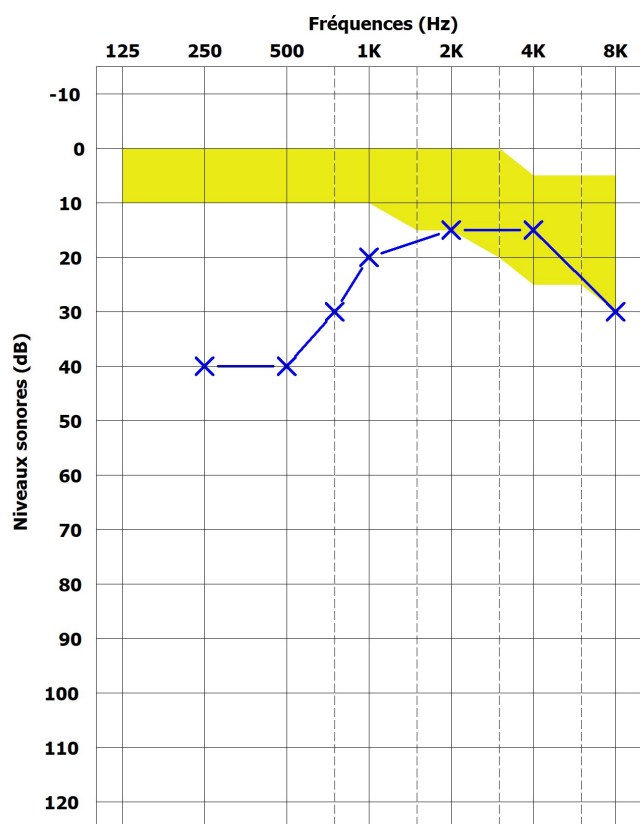

Oreille Gauche

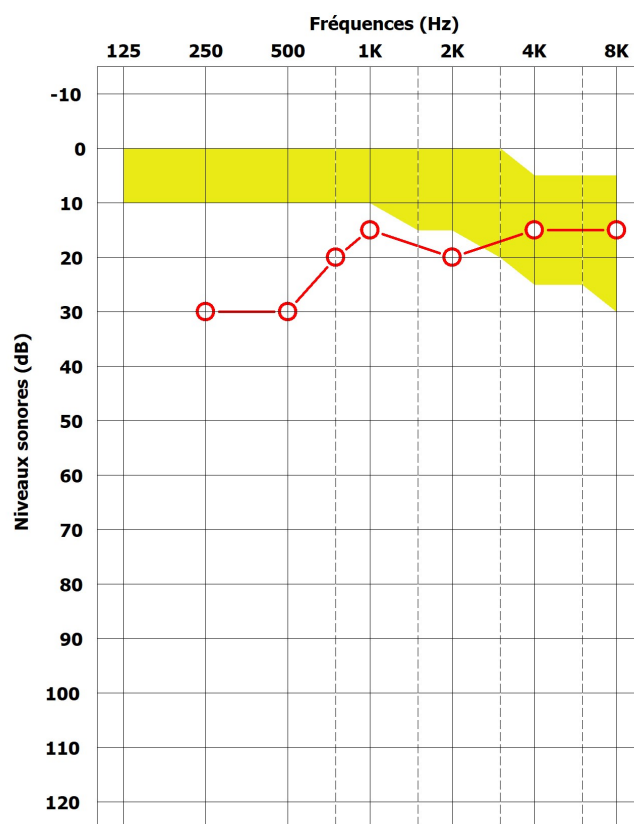

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		40	40	30	20		15		15		30
CA Droit		30	30	20	15		20		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes