


MEDVIE

Date du test: 30/09/2024 13:05:17

Durée: 7mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

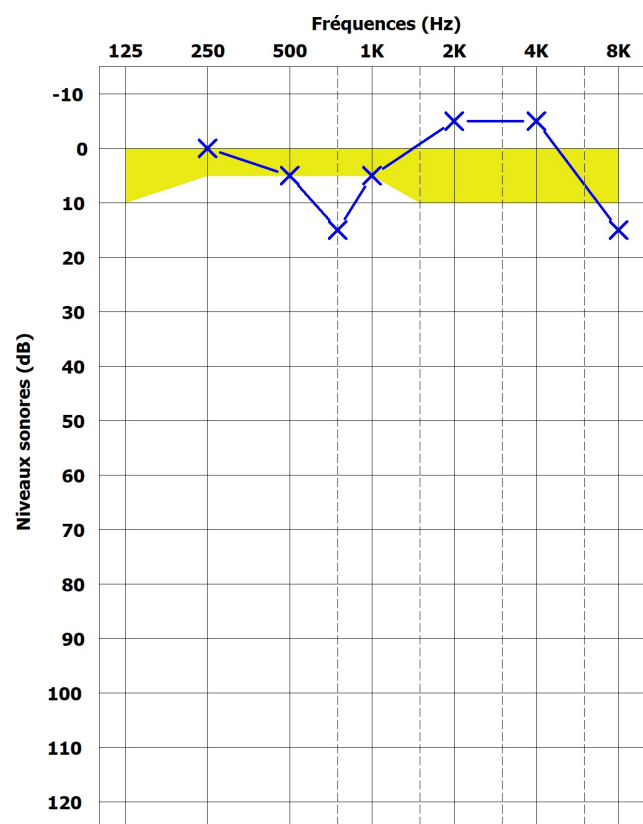

Oreille Gauche

Données Patient		SQUARE BANGALY
Date de naissance	12/05/1996	
Age	28	
Société	CR18	
ID	24093012372531879	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

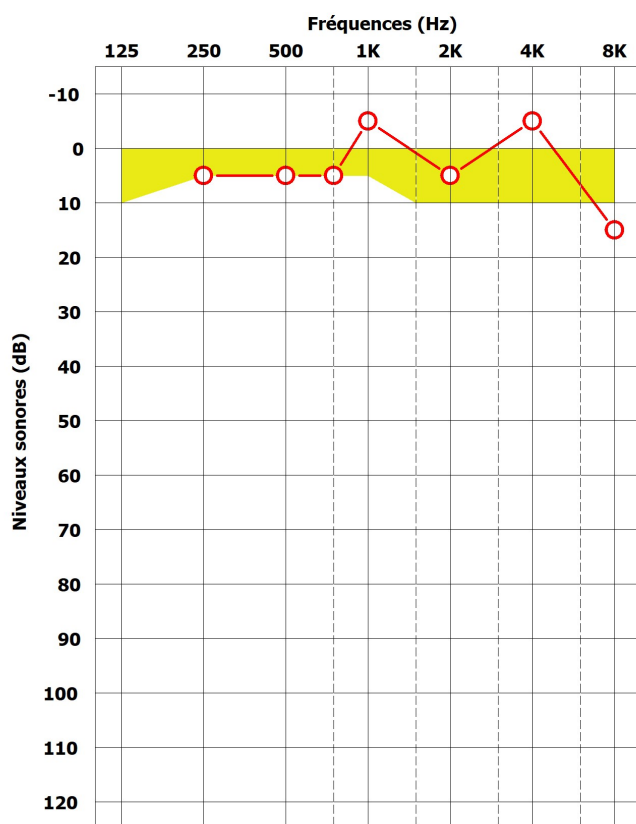

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	5	15	5		-5		-5		15
CA Droit		5	5	5	-5		5		-5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	0,0 dB	---

Notes