



Données Patient		CAMARA SAÏDOU
Date de naissance	01/01/1995	
Age	29	
Société	CR18	
ID	24052514254687244	

Date du test: 25/05/2024 14:38:38
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

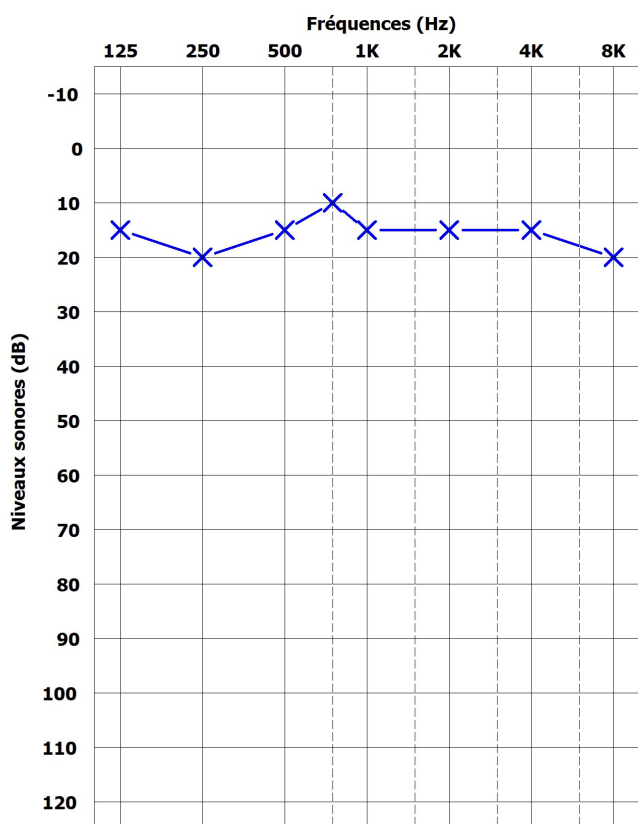

Oreille Gauche

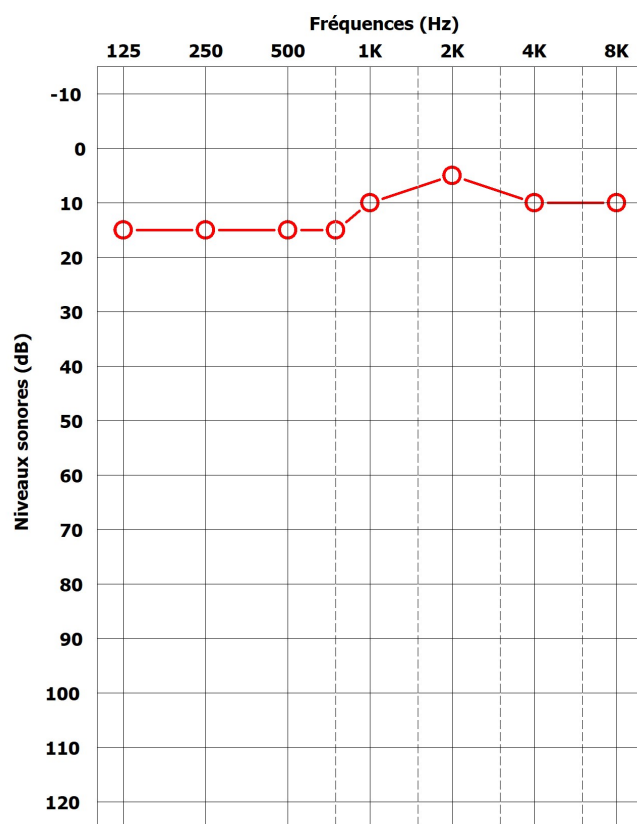

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	20	15	10	15		15		15		20
CA Droit	15	15	15	15	10		5		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes