

Données Patient

CONDE MORY

Date de naissance 15/12/1980
Age 44
Société CR18
ID 25011512523668818


Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021


Date du test: 15/01/2025 12:55:19

Durée: 2mn 31s

Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

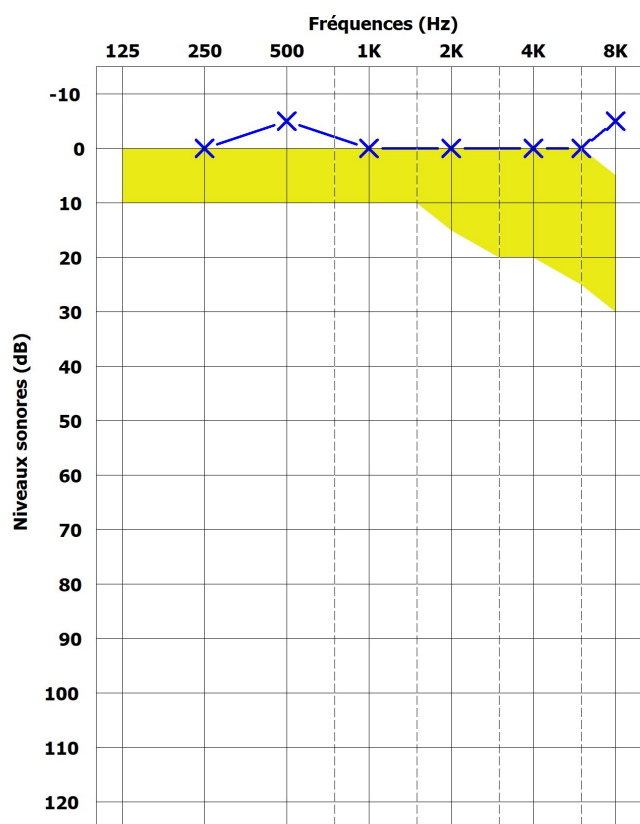

Oreille Gauche

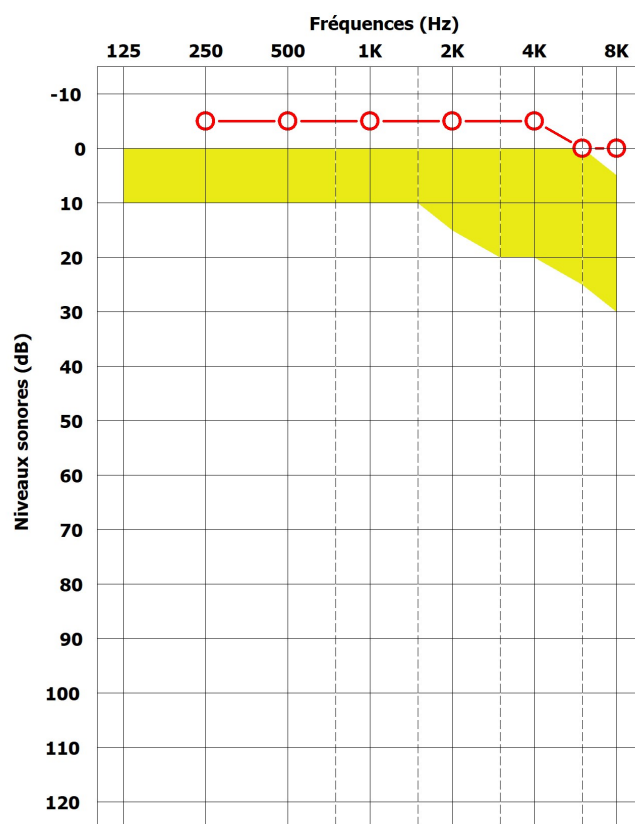

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	-5		0		0		0	0	-5
CA Droit		-5	-5		-5		-5		-5	0	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	-5,0 dB

Notes