


MEDVIE BEYLA


Date du test: 16/12/2024 15:20:39
Durée: 6mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE OUMAR
Date de naissance	12/07/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24121615194121808

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

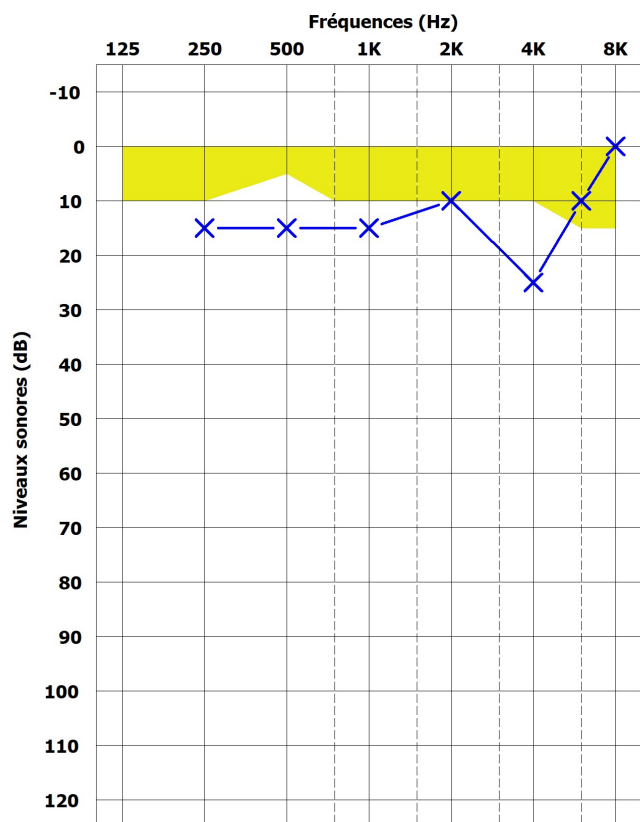

Oreille Gauche

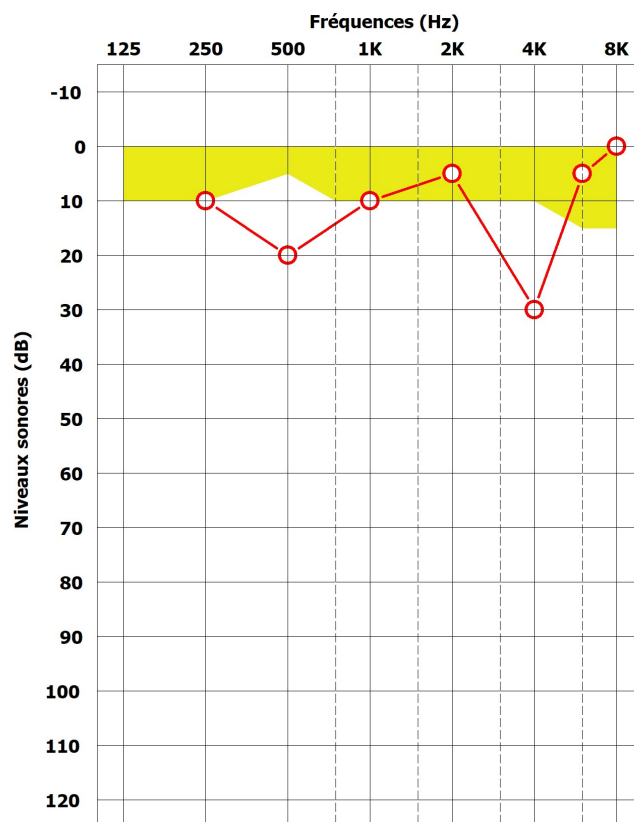

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15		15		10		25	10	0
CA Droit		10	20		10		5		30	5	0

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	10,0 dB

Notes