


MEDVIE


Date du test: 18/04/2024 13:18:54
Durée: 14mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	SIDIBE SACKO
Date de naissance	10/10/1975
Age	48
Société	CR18
ID	24041813171196817

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

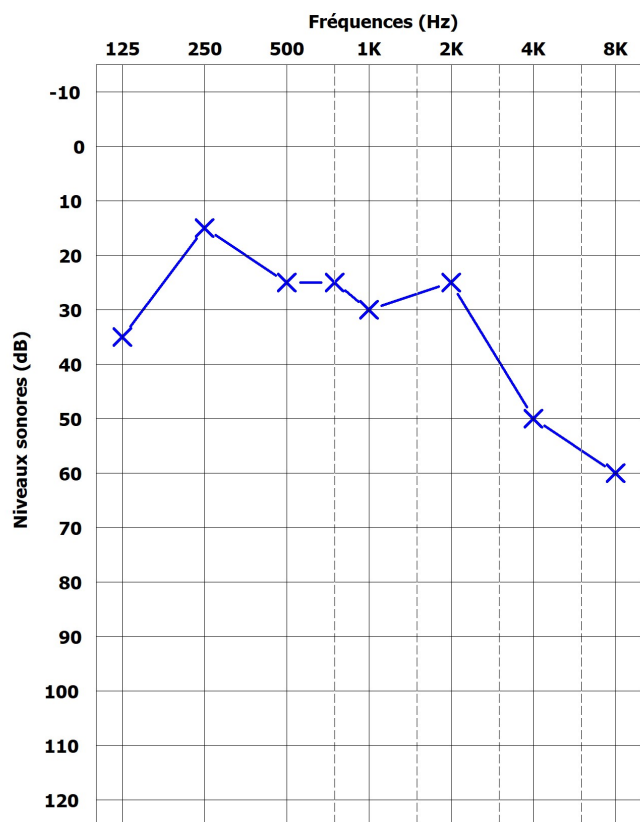

Oreille Gauche

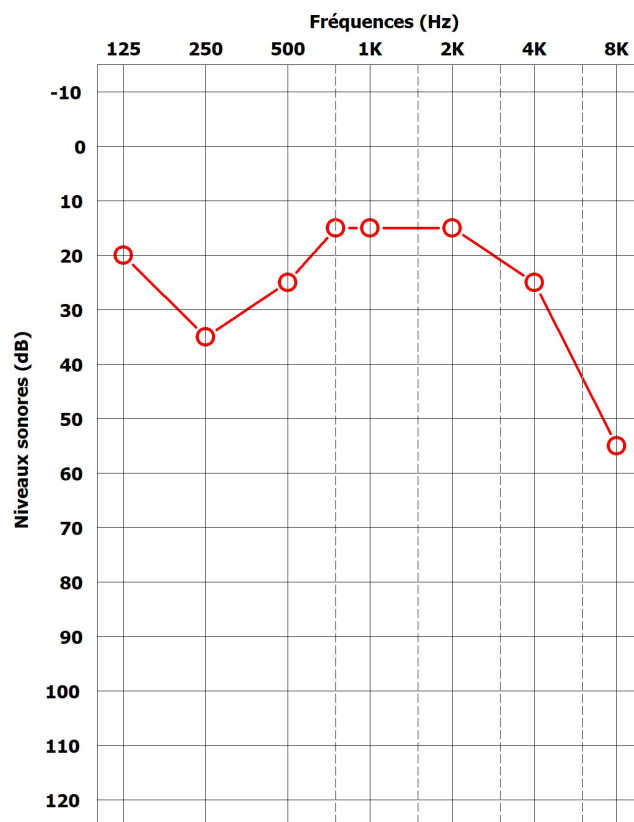

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	15	25	25	30		25		50		60
CA Droit	20	35	25	15	15		15		25		55

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	32,5 dB	---
CA Droit	20,0 dB	---

Notes