


MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 13:54:28
Durée: 5mn 35s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA ARAFAN	
Date de naissance	01/01/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24031413520472558

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

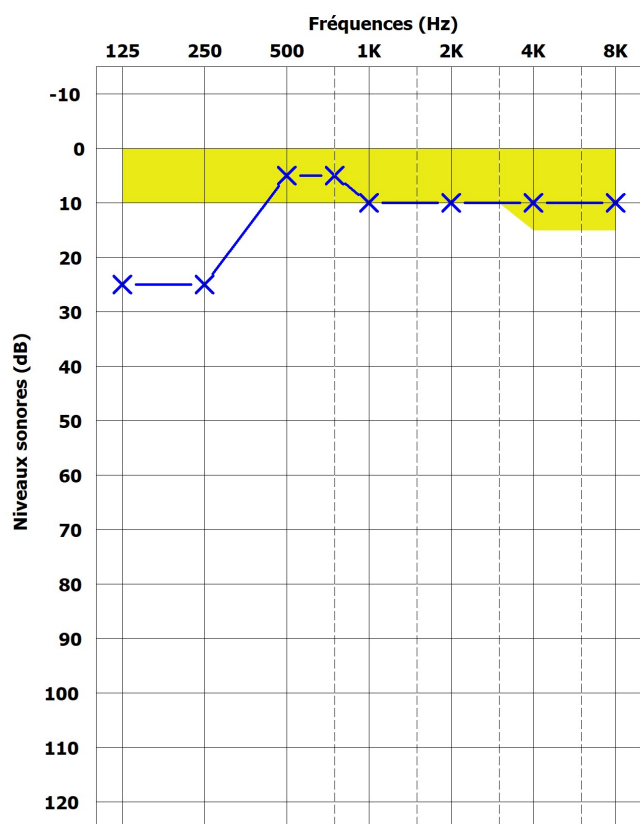

Oreille Gauche

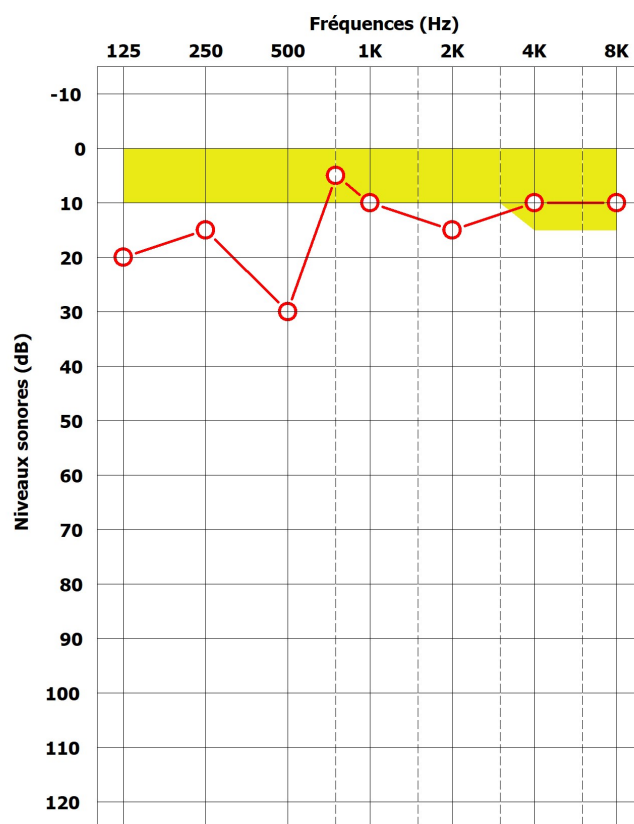

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	5	5	10		10		10		10
CA Droit	20	15	30	5	10		15		10		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes