


MEDVIE


Date du test: 30/06/2025 17:55:59
Durée: 5mn 01s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
XU JUANCAI	
Date de naissance	23/08/1973
Age	51
Société	CR18
ID	25063017542464941

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

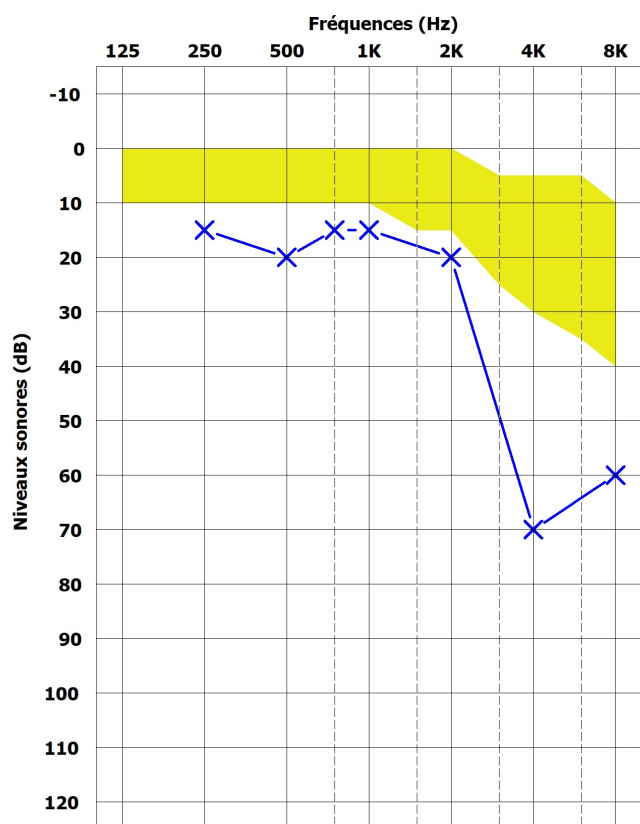

Oreille Gauche

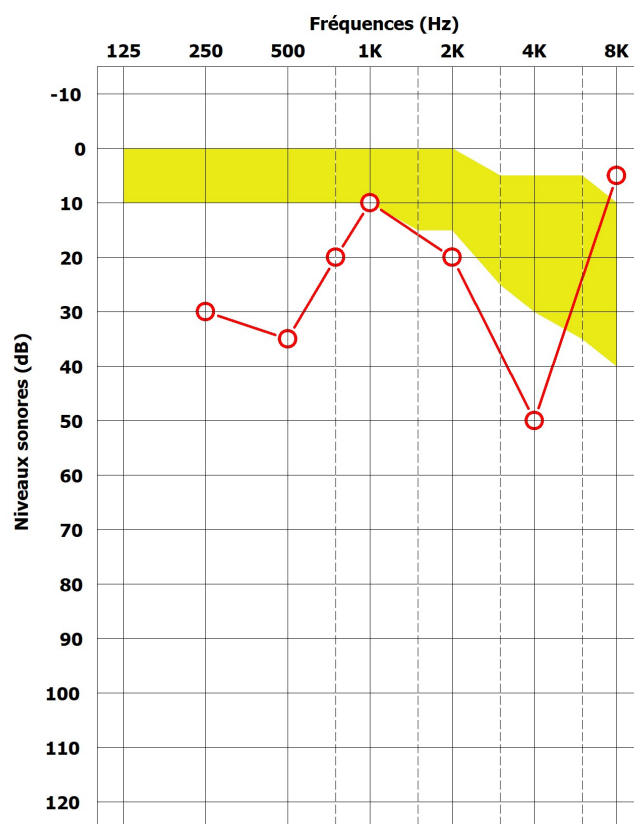

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	15	15		20		70		60
CA Droit		30	35	20	10		20		50		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	31,3 dB	---
CA Droit	28,8 dB	---

Notes