


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 13:39:23
Durée: 4mn 32s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
FOFANA ABDOULAYE	
Date de naissance	01/01/1992
Age	33
Société	CR18
ID	25072913344197277

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

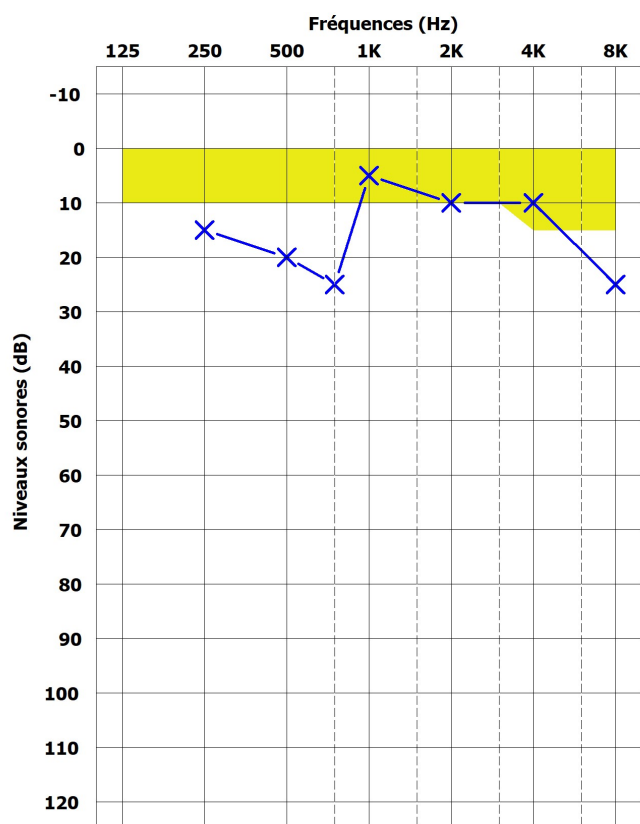

Oreille Gauche

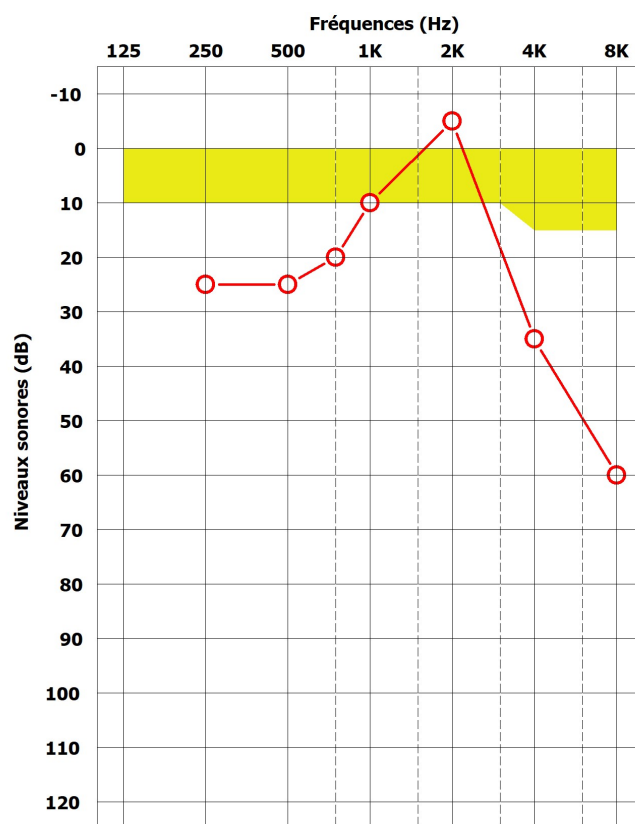

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	20	25	5		10		10		25
CA Droit		25	25	20	10		-5		35		60

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes