


MEDVIE


Date du test: 09/04/2025 13:28:23
Durée: 3mn 20s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MALICK	
Date de naissance	01/01/1982
Age	43
Société	CR18
ID	25040913213760323

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

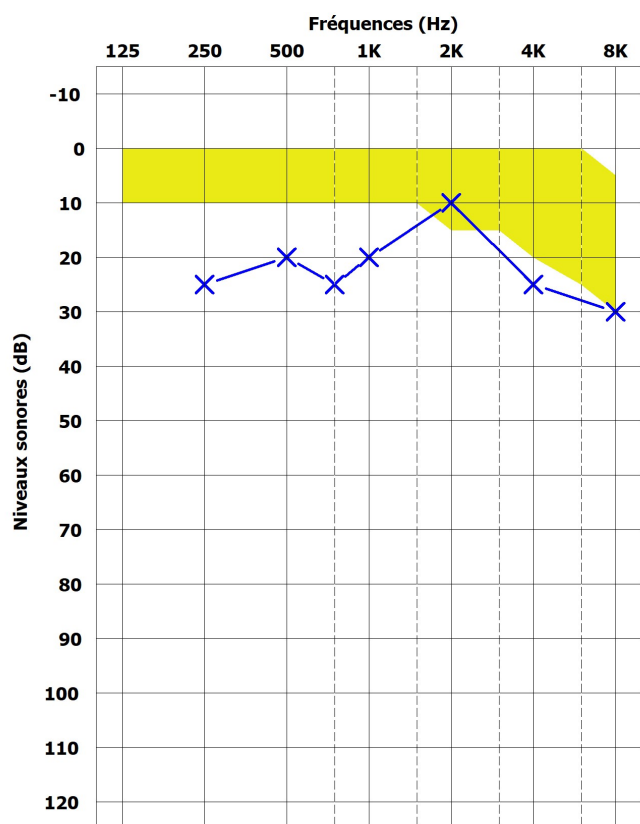

Oreille Gauche

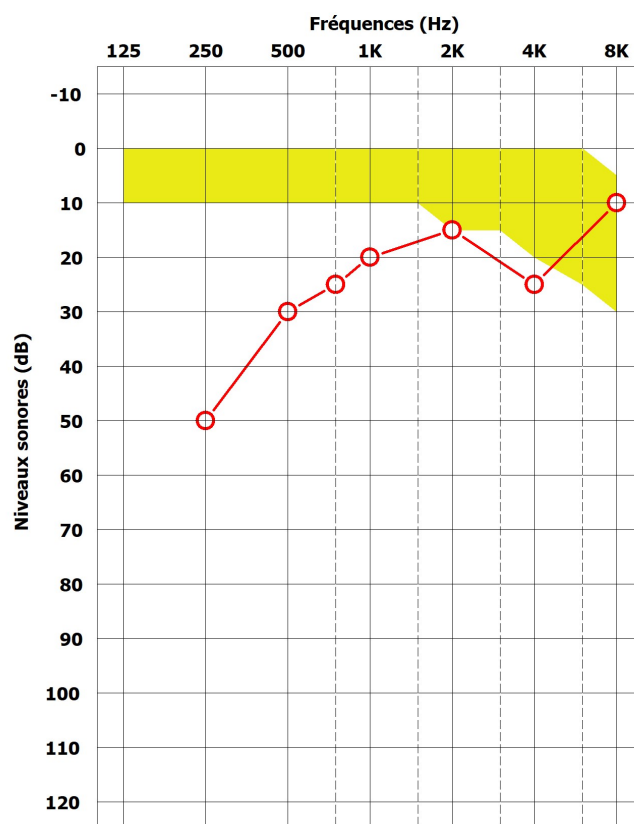

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	25	20		10		25		30
CA Droit		50	30	25	20		15		25		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes