


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 17:41:17
Durée: 7mn 51s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TRAORE IDRISSE	
Date de naissance	01/01/2002
Age	22
Société	CR18
ID	24050117351703398

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

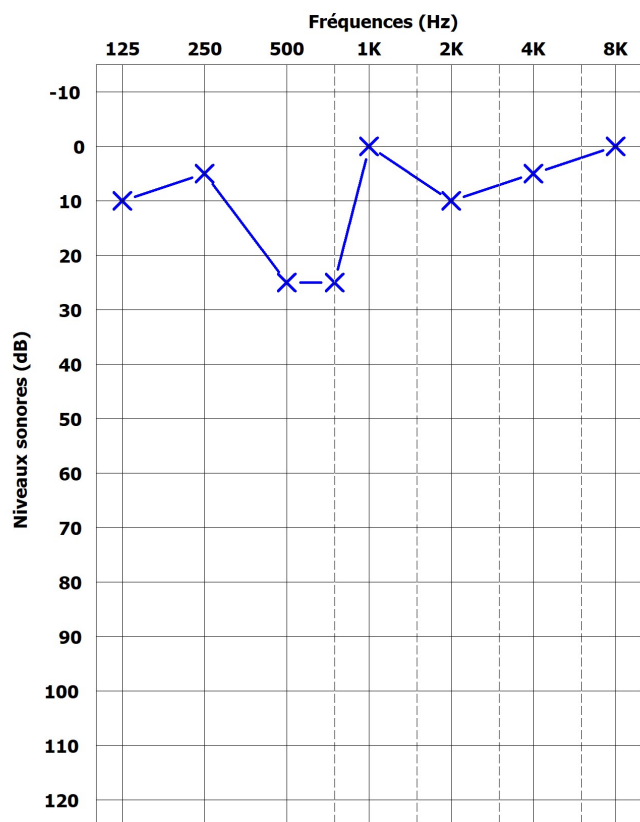

Oreille Gauche

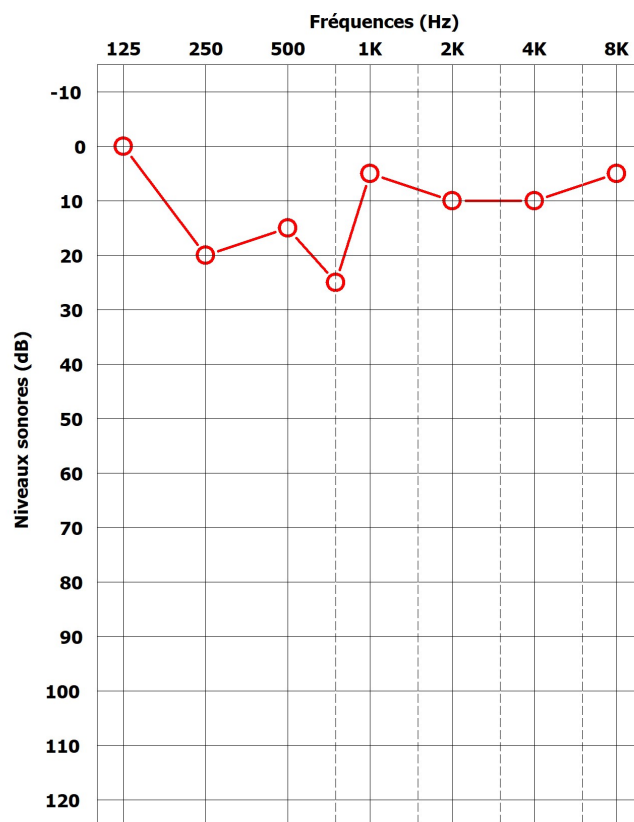

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	5	25	25	0		10		5		0
CA Droit	0	20	15	25	5		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes