


MEDVIE


Date du test: 14/03/2025 13:51:55

Durée: 3mn 55s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

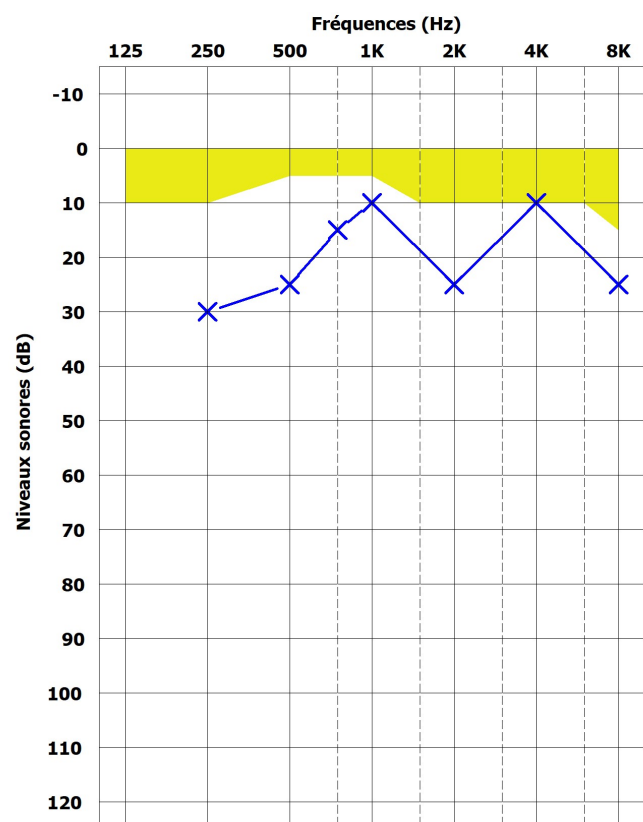

Oreille Gauche

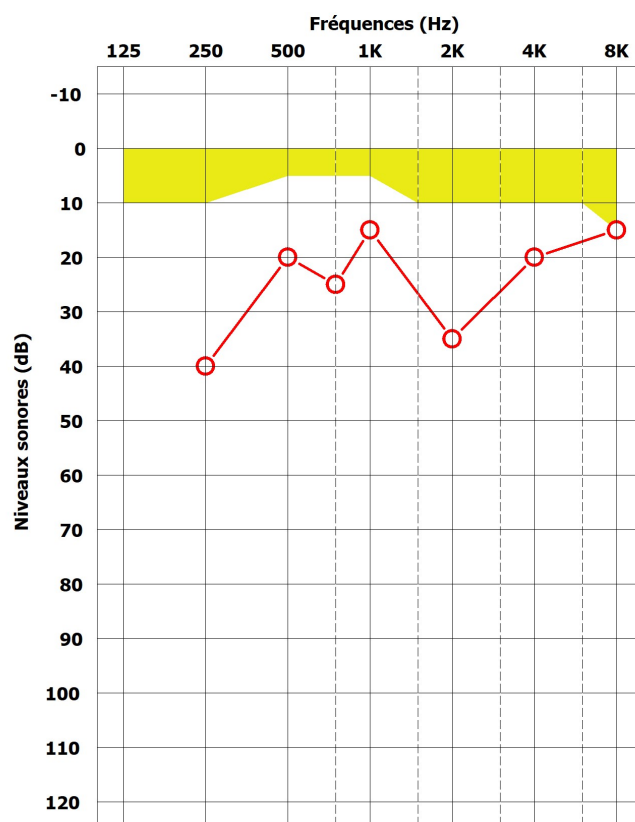

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	15	10		25		10		25
CA Droit		40	20	25	15		35		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	22,5 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA DJIBA
Date de naissance	05/06/1994
Age	30
Société	CR18
ID	25031413493116224

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021