


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 12:52:51
Durée: 3mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEITA AMADOU	
Date de naissance	25/10/1998
Age	25
Société	CR18
ID	24100112502258630

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

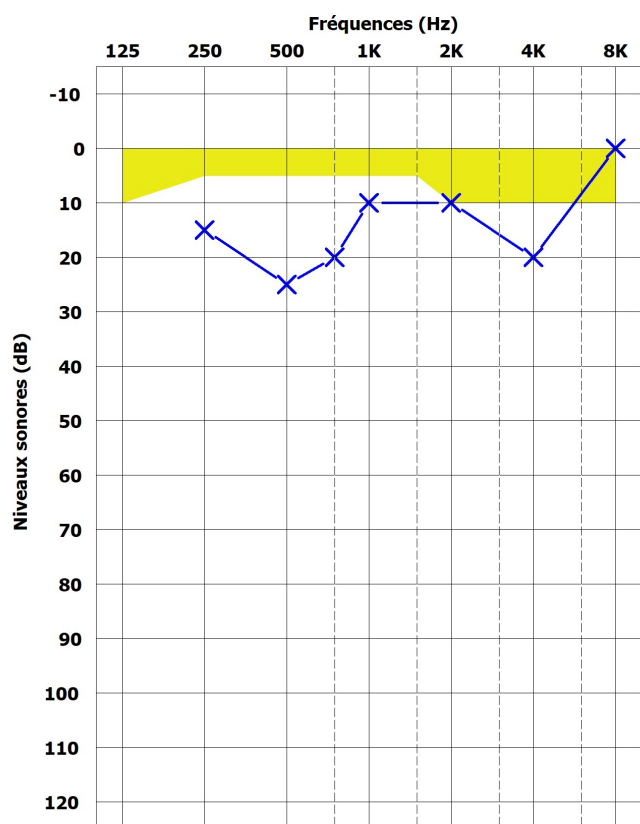

Oreille Gauche

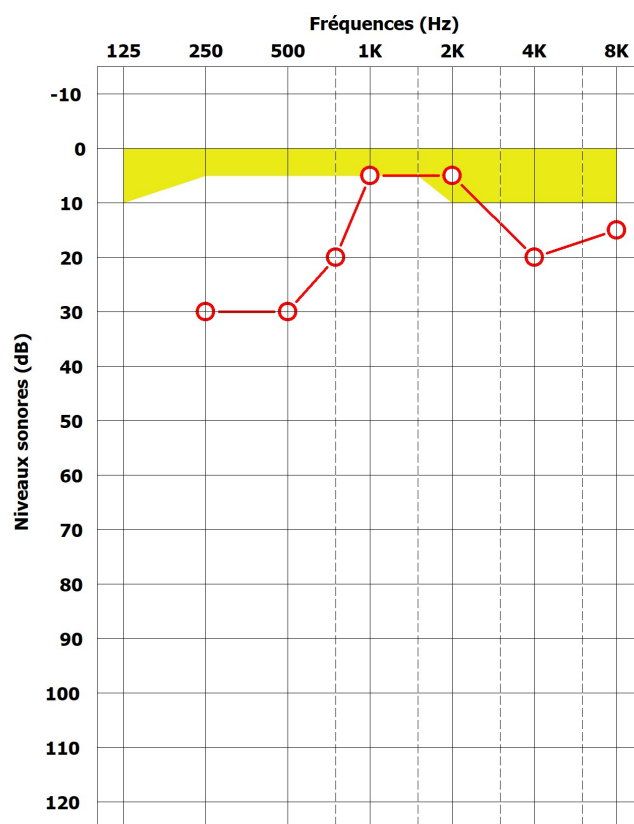

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	25	20	10		10		20		0
CA Droit		30	30	20	5		5		20		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes