


MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 15:19:43
Durée: 8mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA SEKOU
Date de naissance	01/01/1984	
Age	40	
Société	CR18	
ID	24031815174610838	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

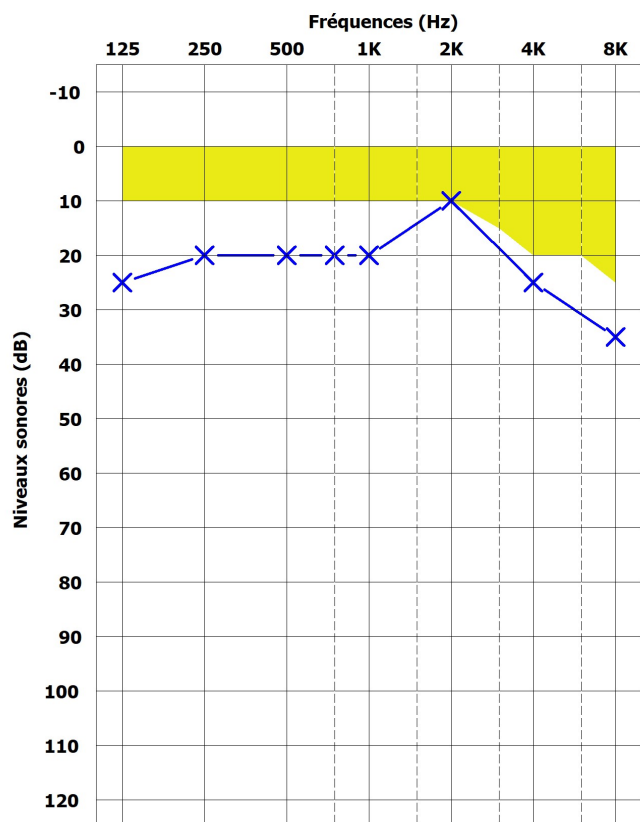

Oreille Gauche

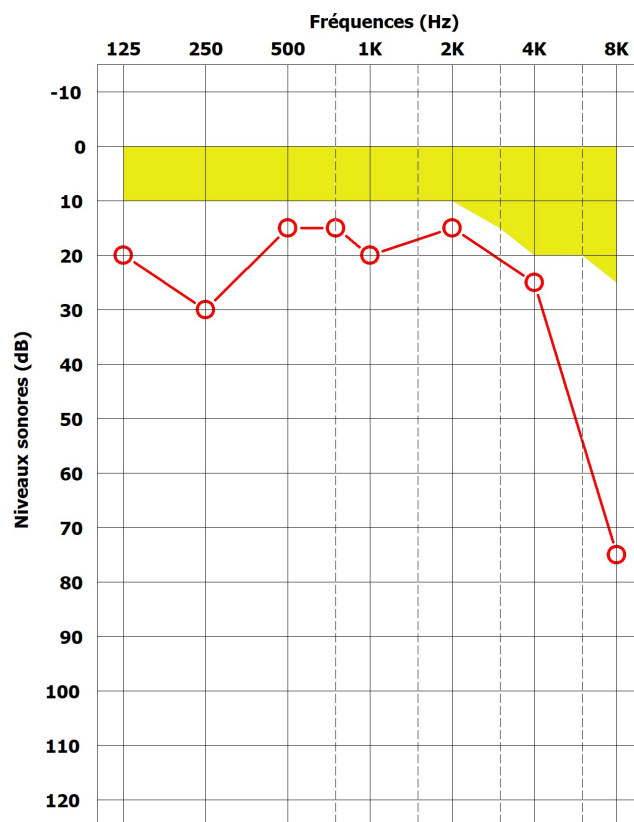

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	20	20	20	20		10		25		35
CA Droit	20	30	15	15	20		15		25		75

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes