


MEDVIE


Date du test: 11/07/2025 12:13:19

Durée: 5mn 15s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

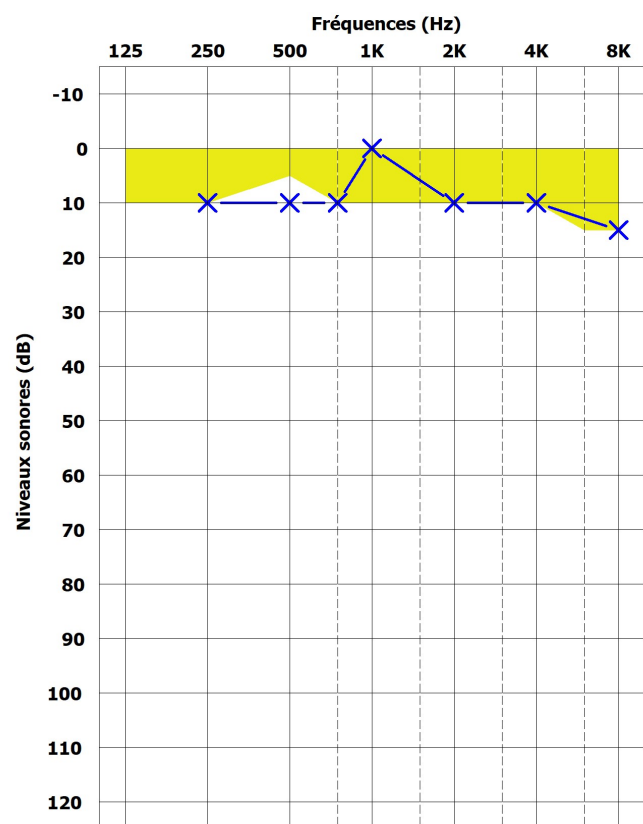

Oreille Gauche

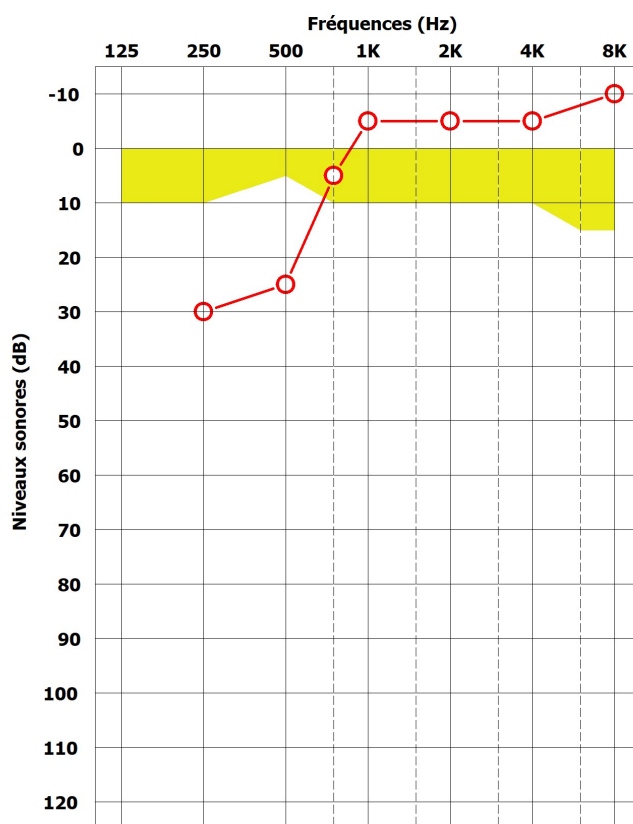

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	0		10		10		15
CA Droit		30	25	5	-5		-5		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes

Données Patient	QIANG SHUANGLE
Date de naissance	14/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25071112103237891

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021