


MEDVIE


Date du test: 10/05/2024 16:17:11
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Données Patient	KONATE KARAMO
Date de naissance	01/01/1989
Age	35
Société	CR18
ID	24051016135077973

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

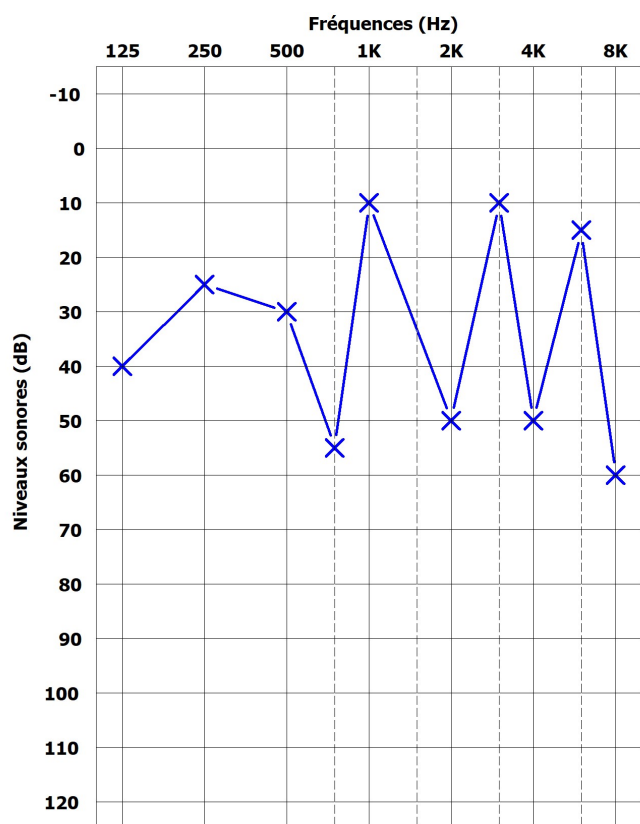

Oreille Gauche

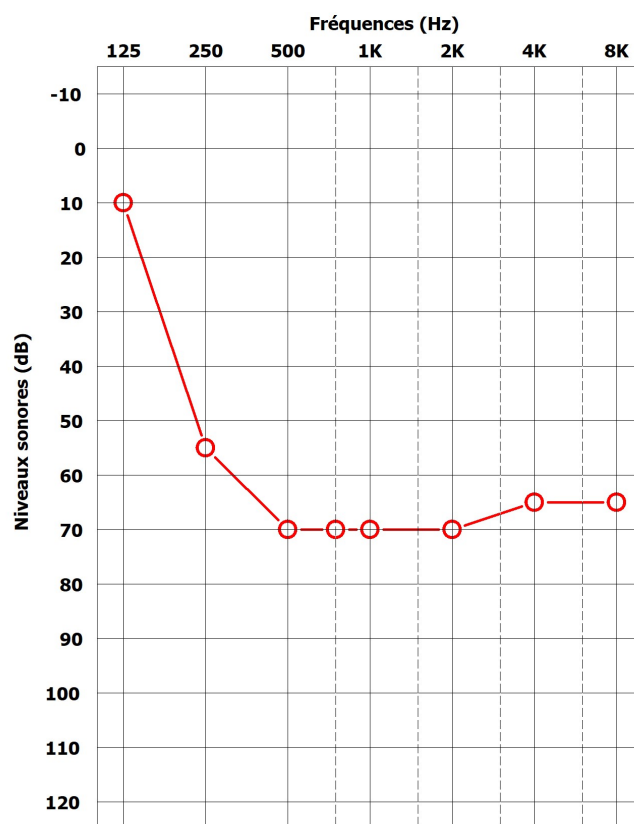

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	40	25	30	55	10		50	10	50	15	60
CA Droit	10	55	70	70	70		70		65		65

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	35,0 dB	25,0 dB
CA Droit	68,8 dB	---

Notes