


MEDVIE


Date du test: 10/12/2024 12:02:28

Durée: 3mn 48s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

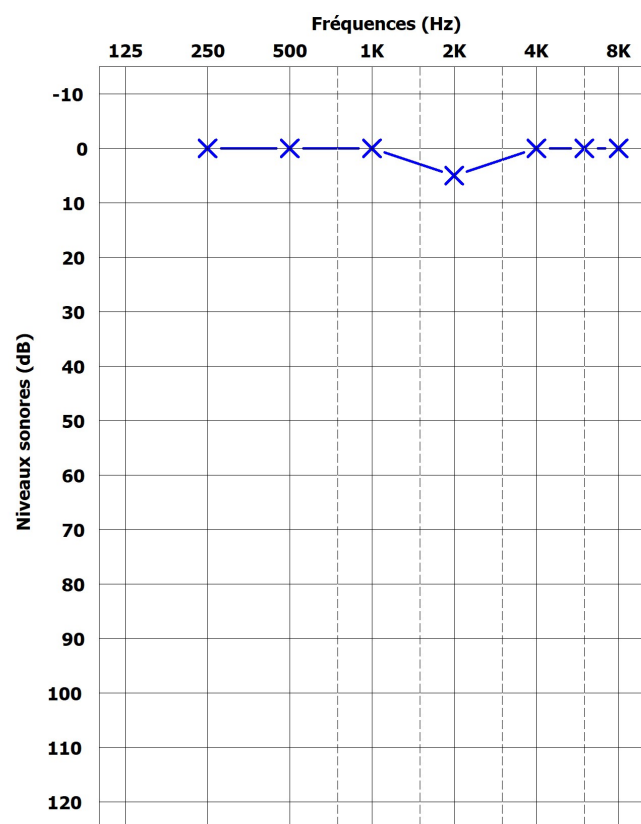

Oreille Gauche

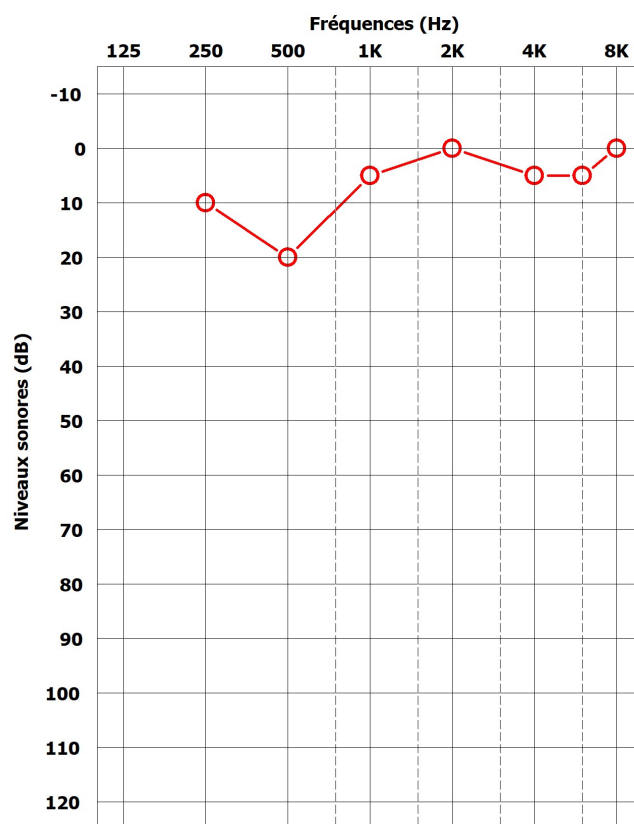

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0		0		5		0	0	0
CA Droit		10	20		5		0		5	5	0

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	0,0 dB
CA Droit	---	5,0 dB

Notes

Données Patient	DIAKITE MOUSSA
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24121012005008138

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021