ELECTRONICA MEDICAL
by Electronica Technologies

Données Patient	DIALLO MAMADOU ALIOU
Date de naissance	18/06/2001
Age	23
Société	CR18
ID	24100114293944920

MEDVIE

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

Date du test: 01/10/2024 14:32:05
Durée: 5mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

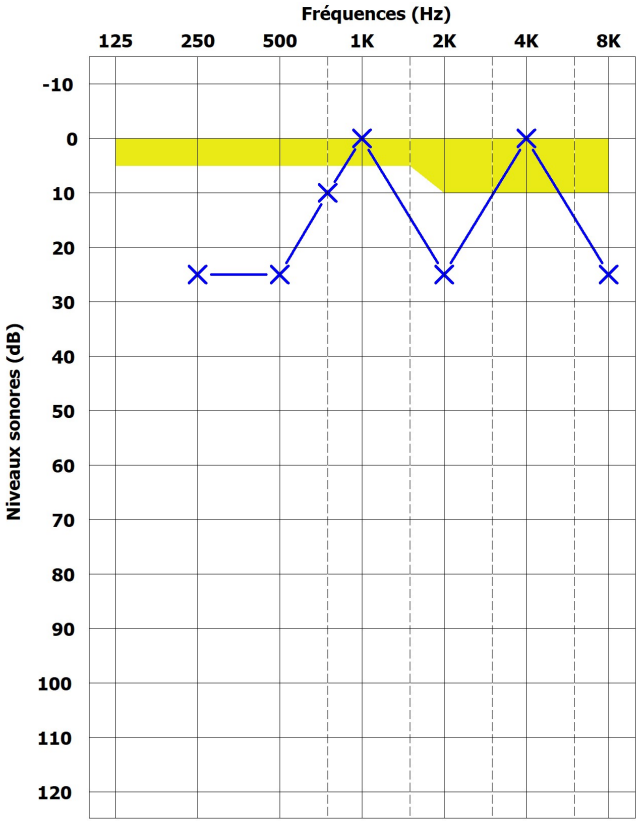

Oreille Gauche

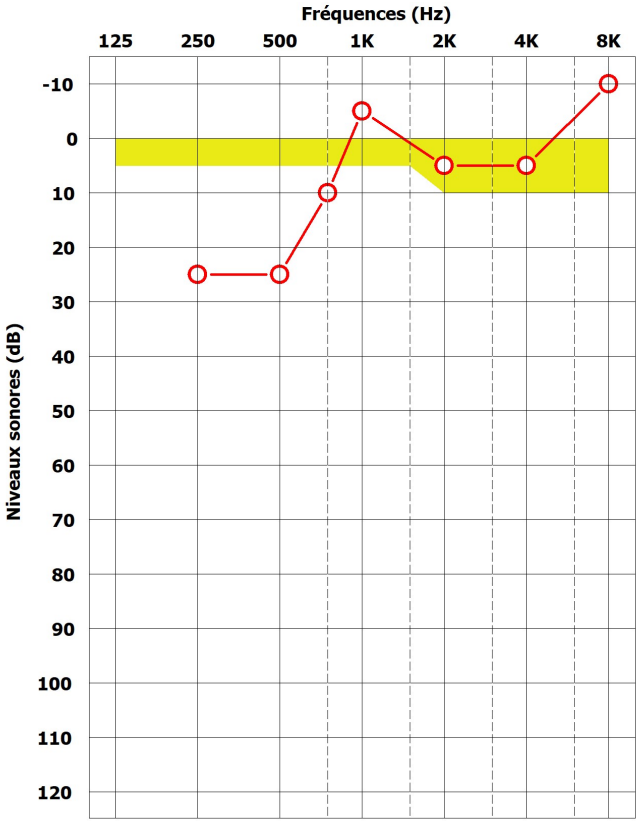

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	10	0		25		0		25
CA Droit		25	25	10	-5		5		5		-10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes

All rights reserved - Electronica Technologies 2020