

MEDVIE

Date du test: 03/10/2024 18:47:38

Durée: 5mn 57s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient **KOUROUMA MOHAMED**

Date de naissance 01/06/1986

Age 38

Société CR18


ID 24100318455105373

Audiomètre


Type: Audio 820M V2,211

Numéro de série: 2111EAT690093

Date Calibration : 30/11/2021

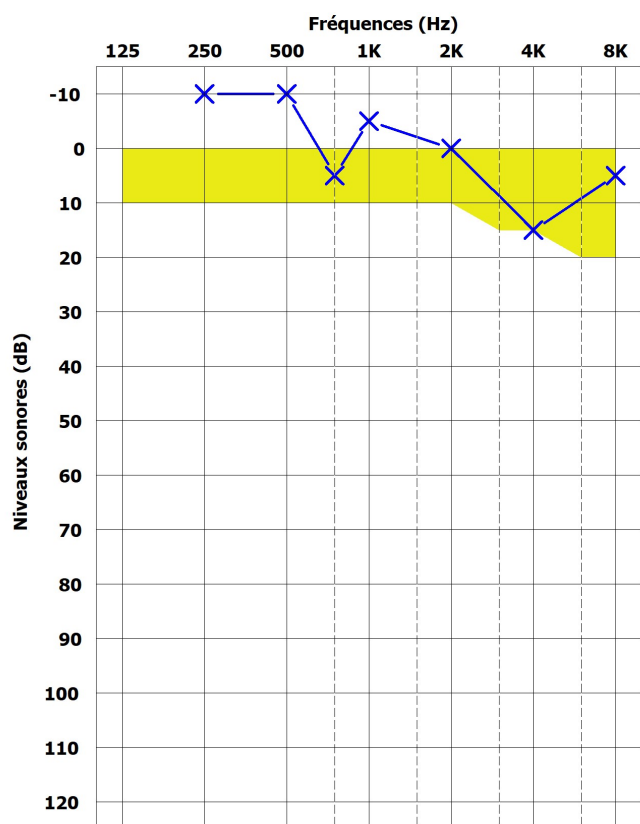

Oreille Gauche

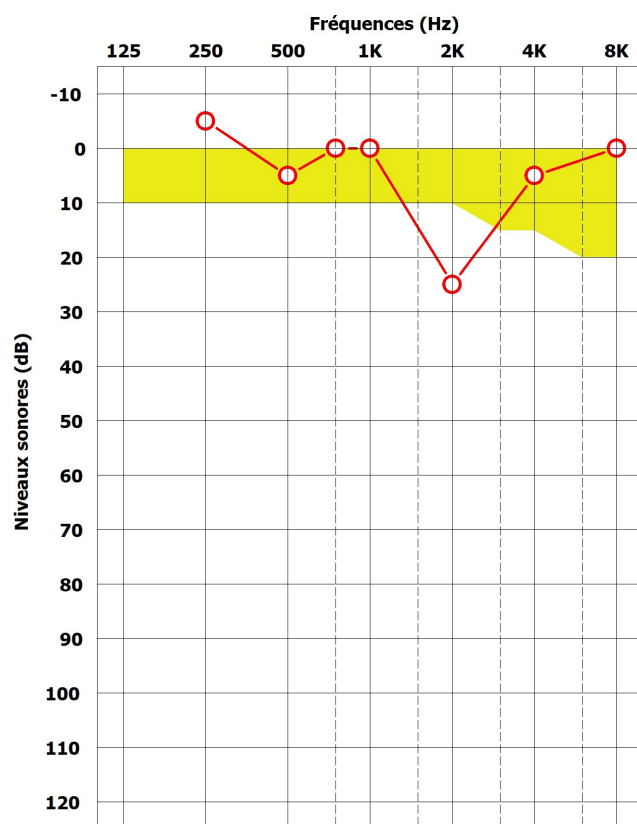

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	5	-5		0		15		5
CA Droit		-5	5	0	0		25		5		0

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes